


**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 1 - Z-score účastníka s kódem 1**

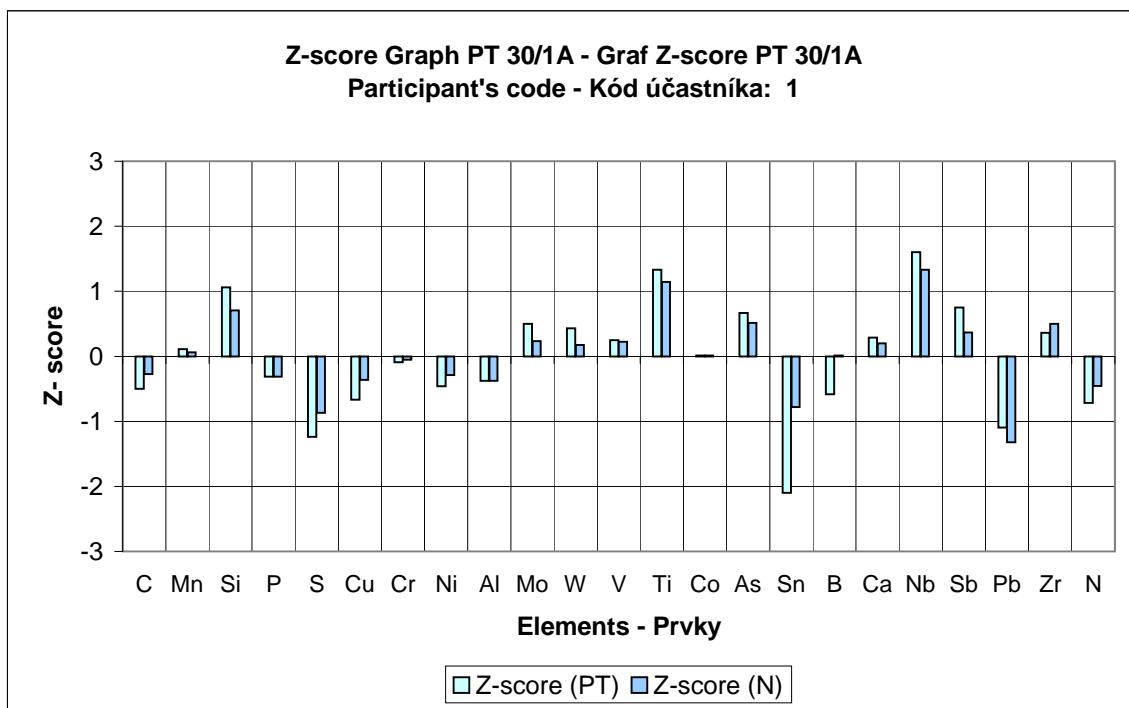

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 2 - Z-score účastníka s kódem 2**

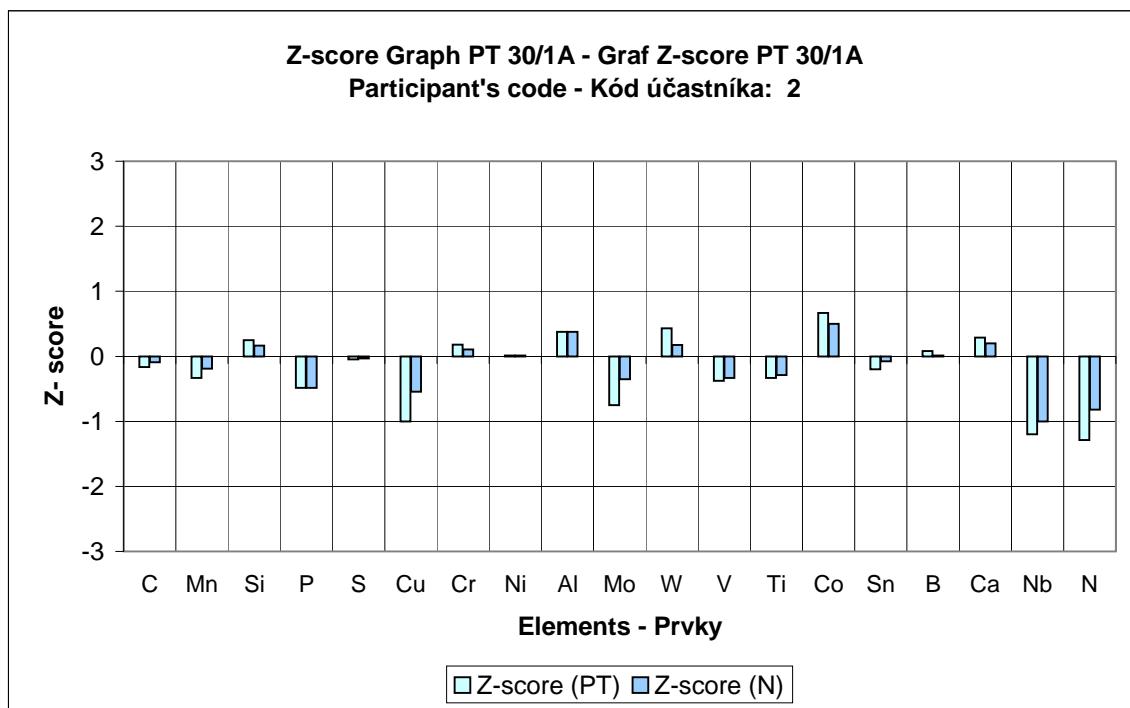

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 3 - Z-score účastníka s kódem 3**

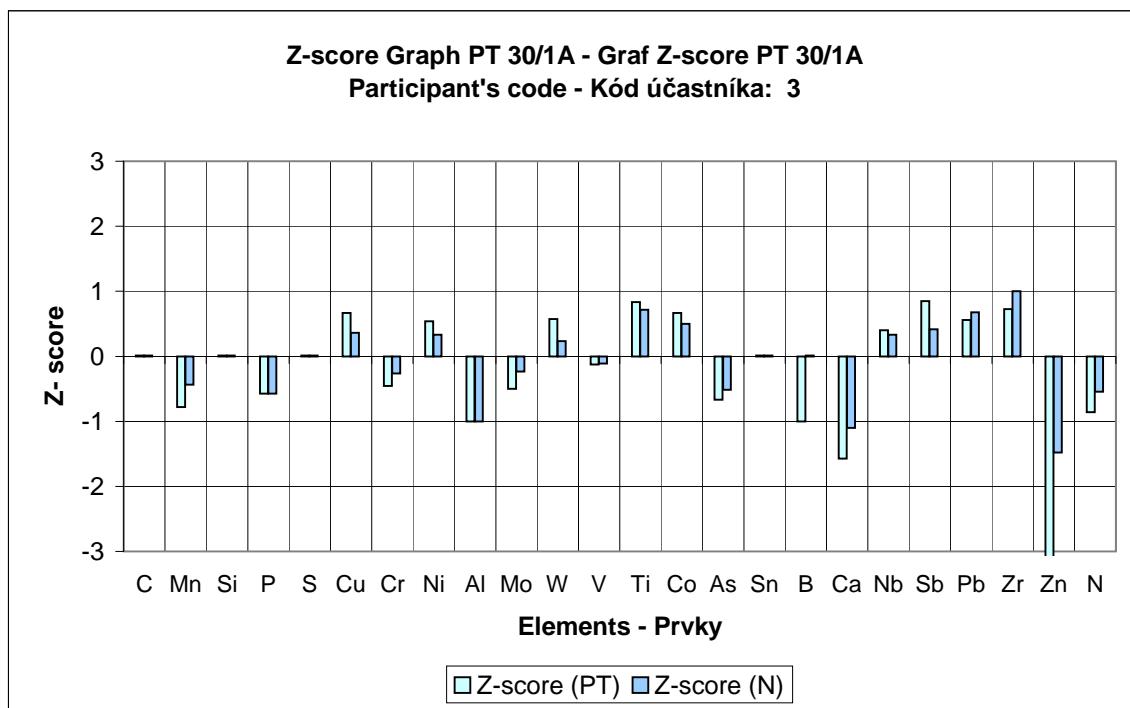

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 4 - Z-score účastníka s kódem 4**

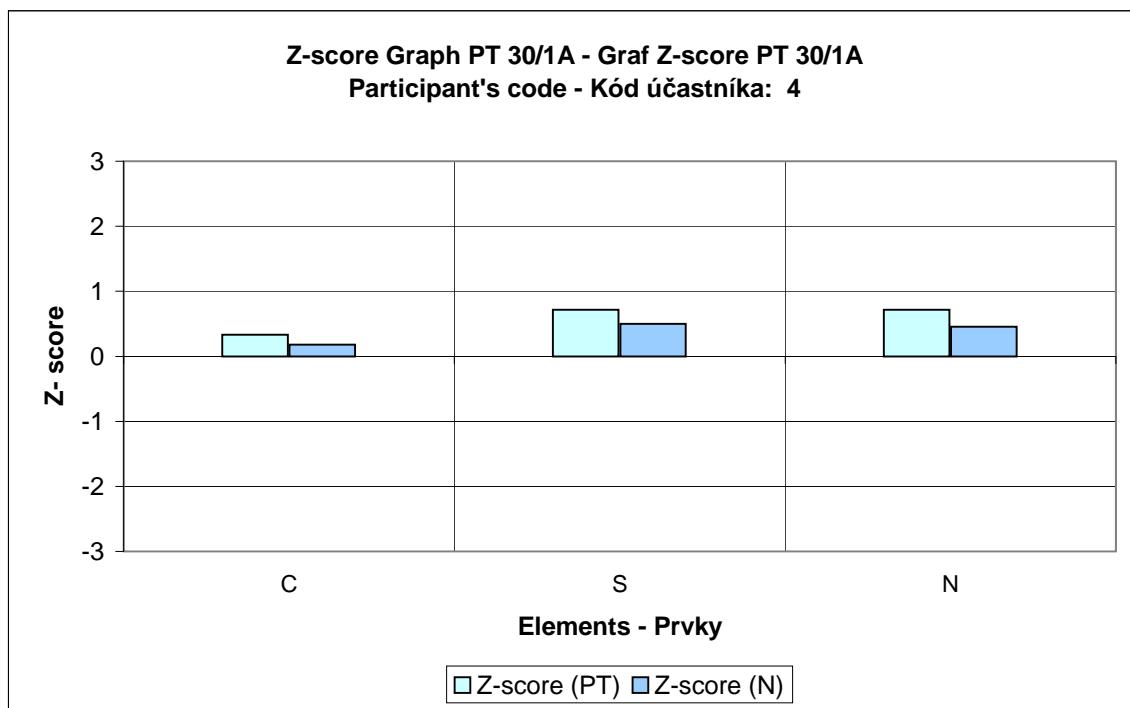

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 5 - Z-score účastníka s kódem 5**

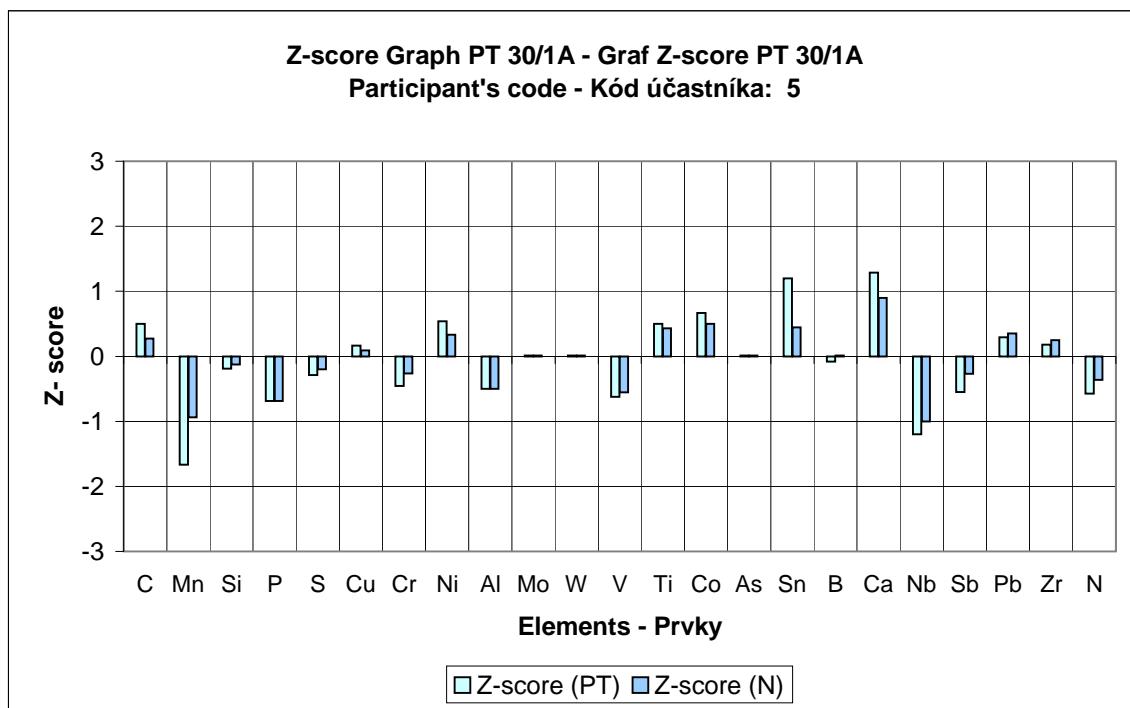

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 6 - Z-score účastníka s kódem 6**

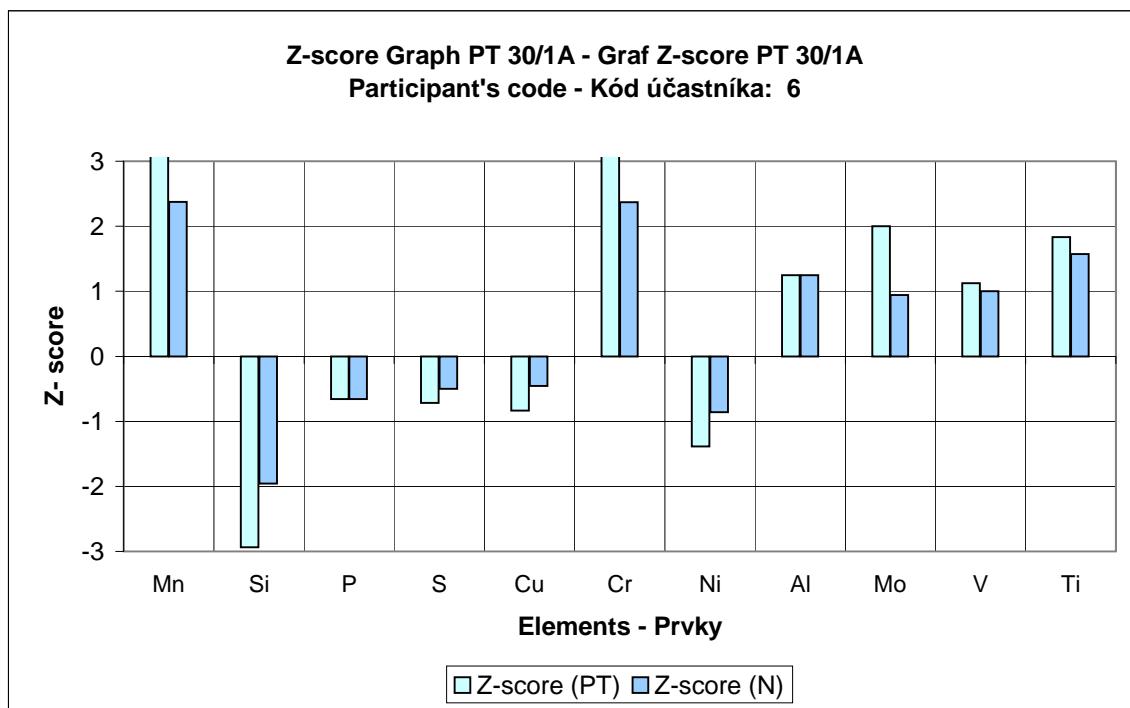

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 7 - Z-score účastníka s kódem 7**

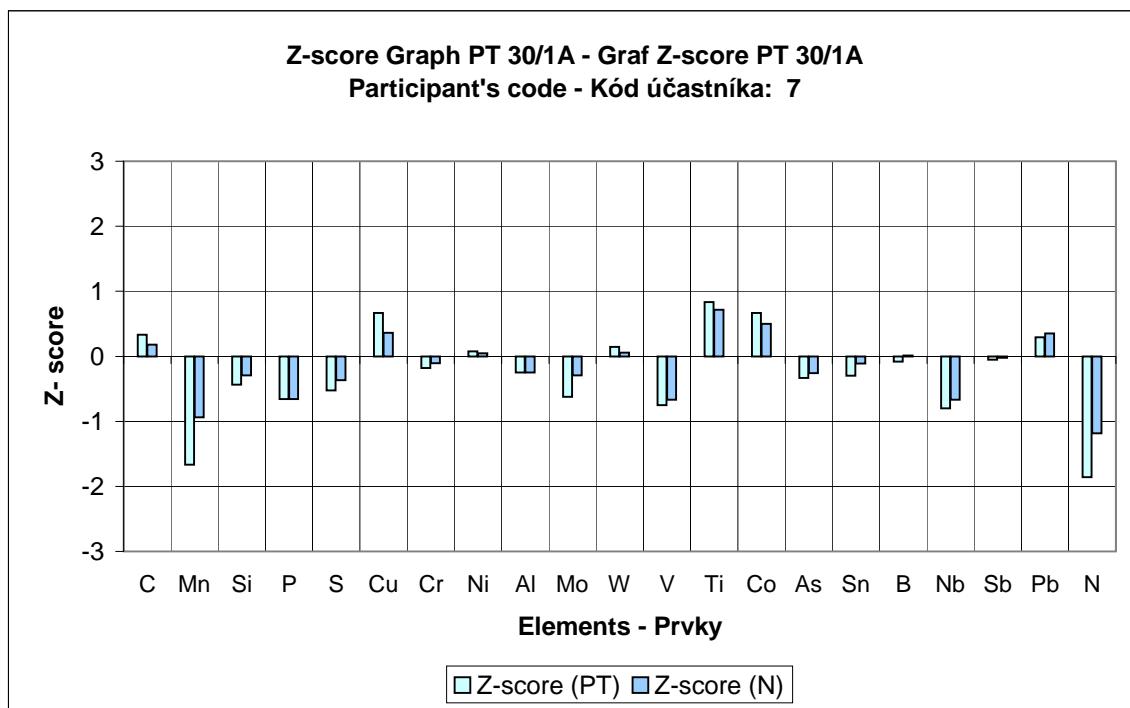

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 8 - Z-score účastníka s kódem 8**

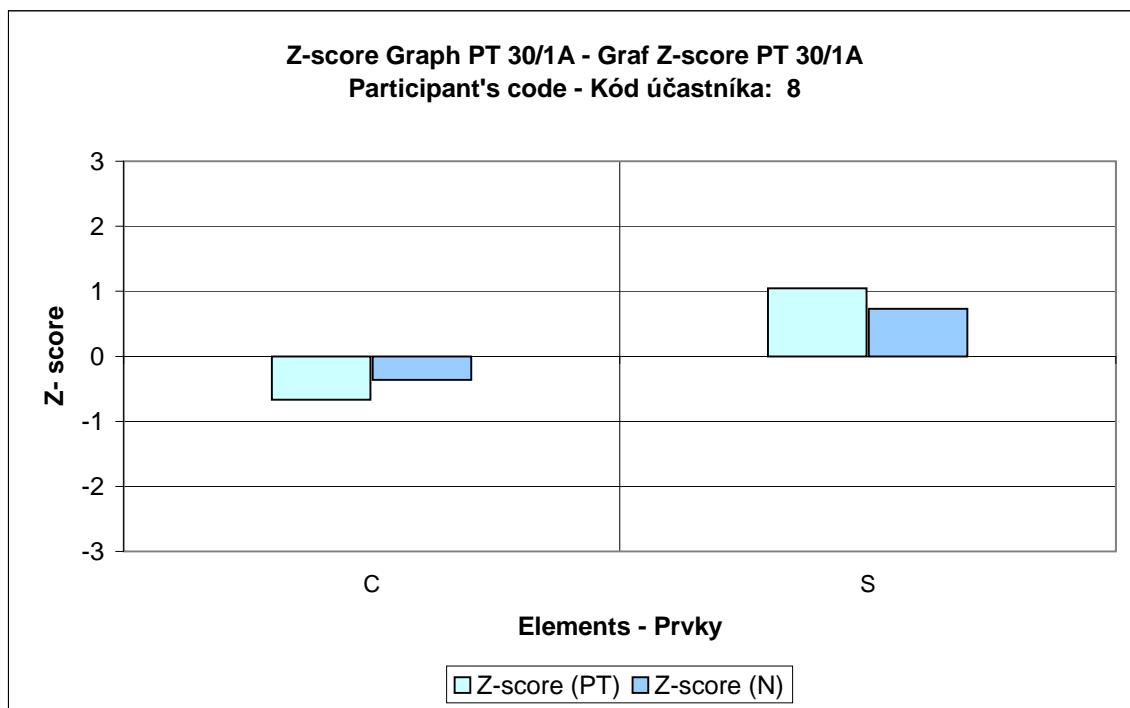

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 9 - Z-score účastníka s kódem 9**

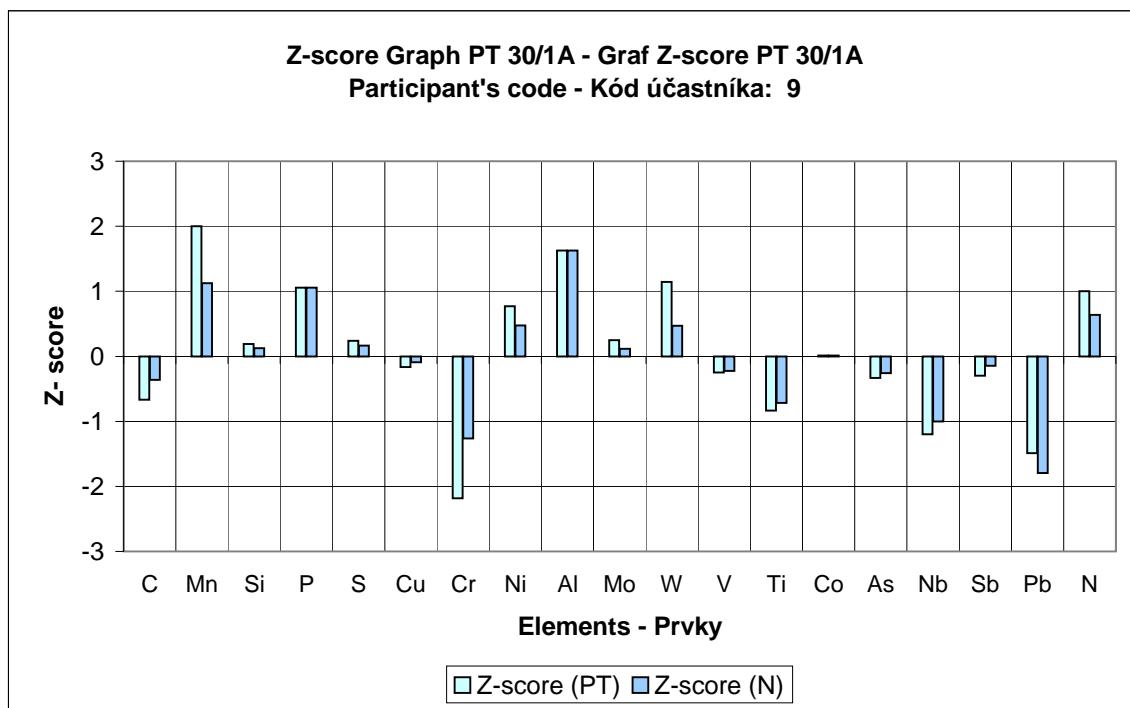

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 10 - Z-score účastníka s kódem 10**

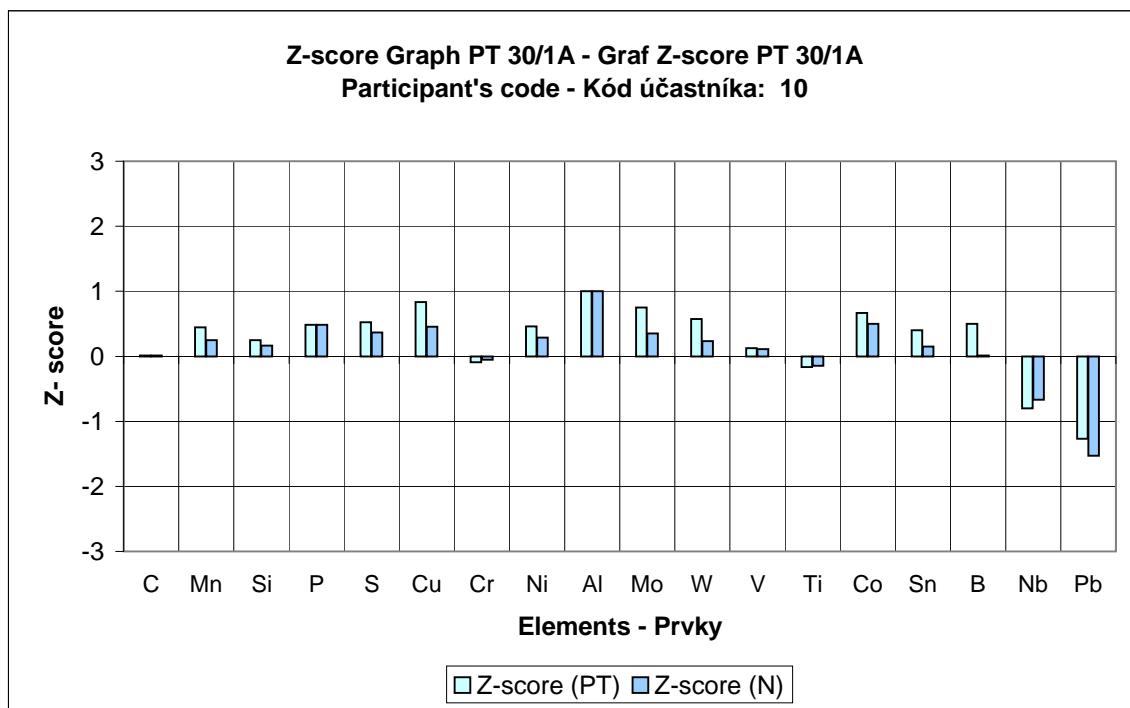

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 11 - Z-score účastníka s kódem 11**

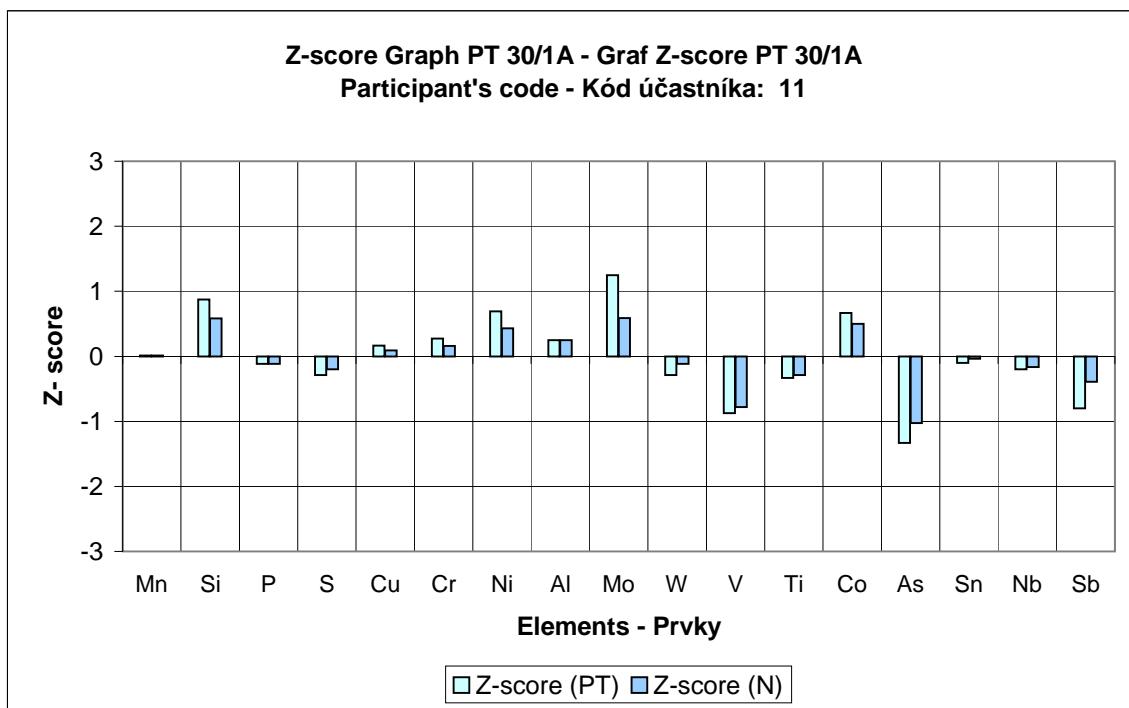

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 12 - Z-score účastníka s kódem 12**

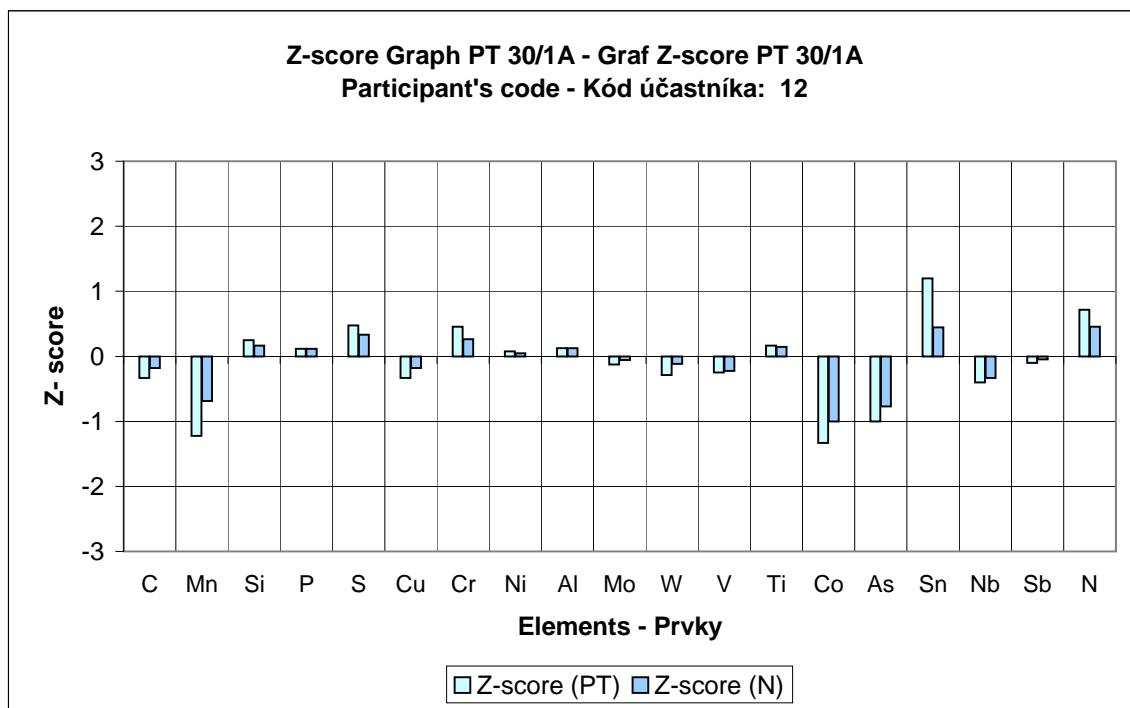

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 13 - Z-score účastníka s kódem 13**

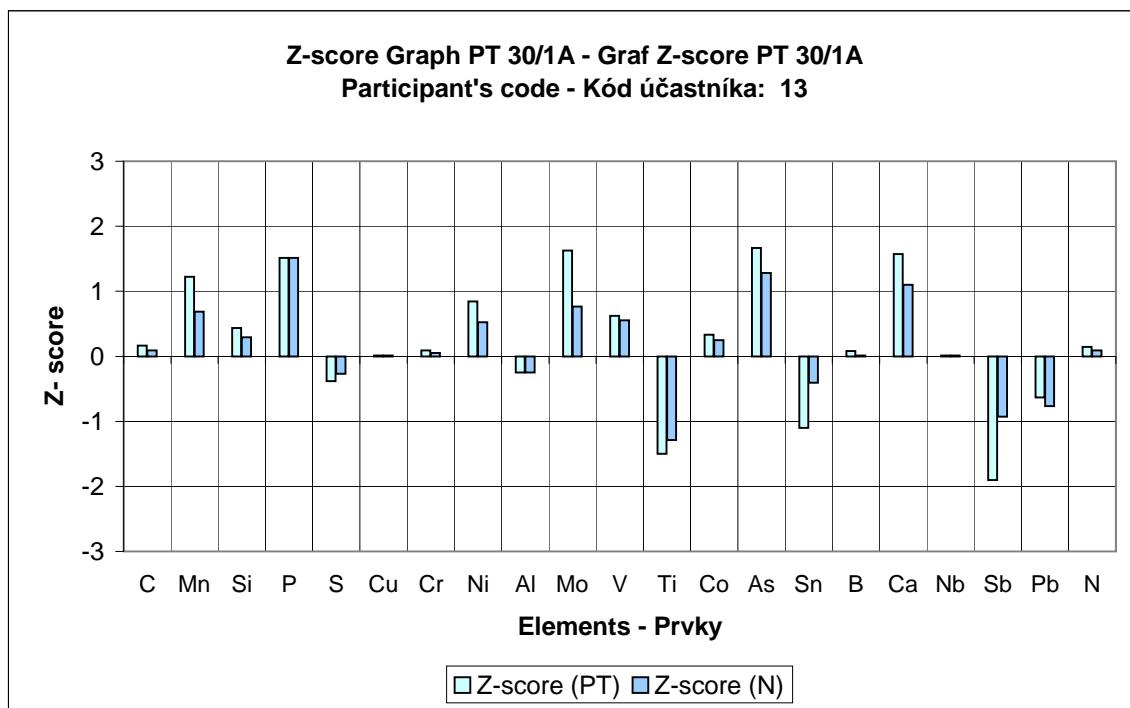

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 14 - Z-score účastníka s kódem 14**

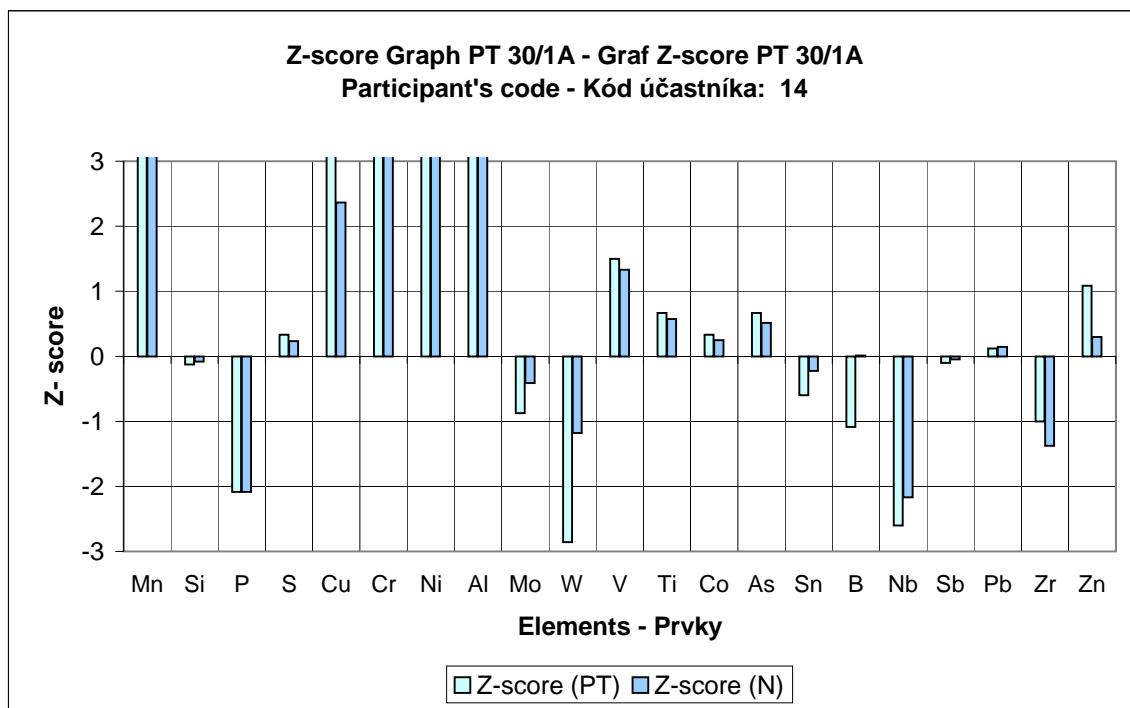

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL  
1. máje 432  
735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 15 - Z-score účastníka s kódem 15**

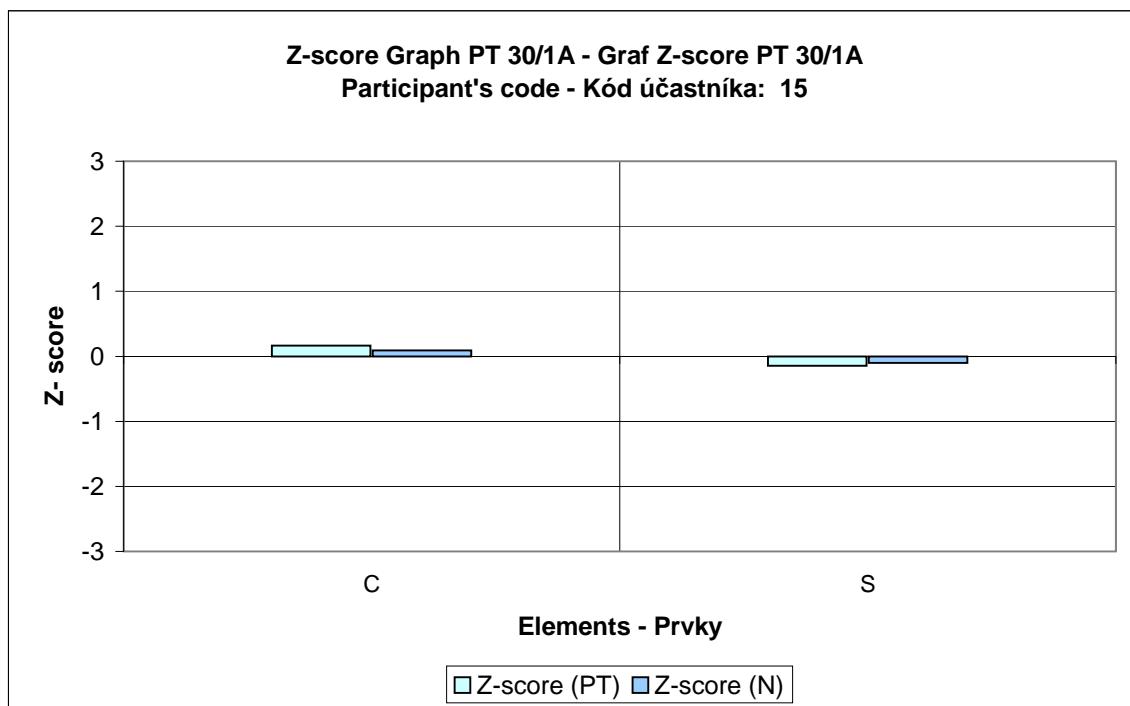

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

## **Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

### **Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

### **Z-scores of the participant with code 16 - Z-score účastníka s kódem 16**

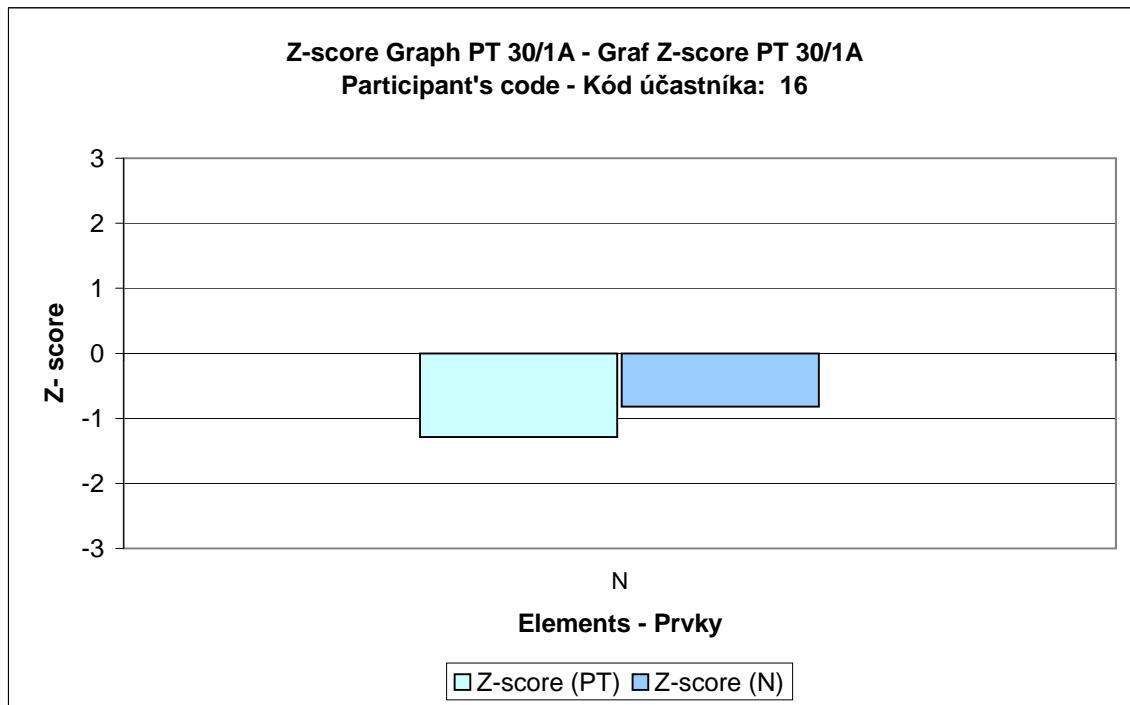

#### **Comments Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 17 - Z-score účastníka s kódem 17**

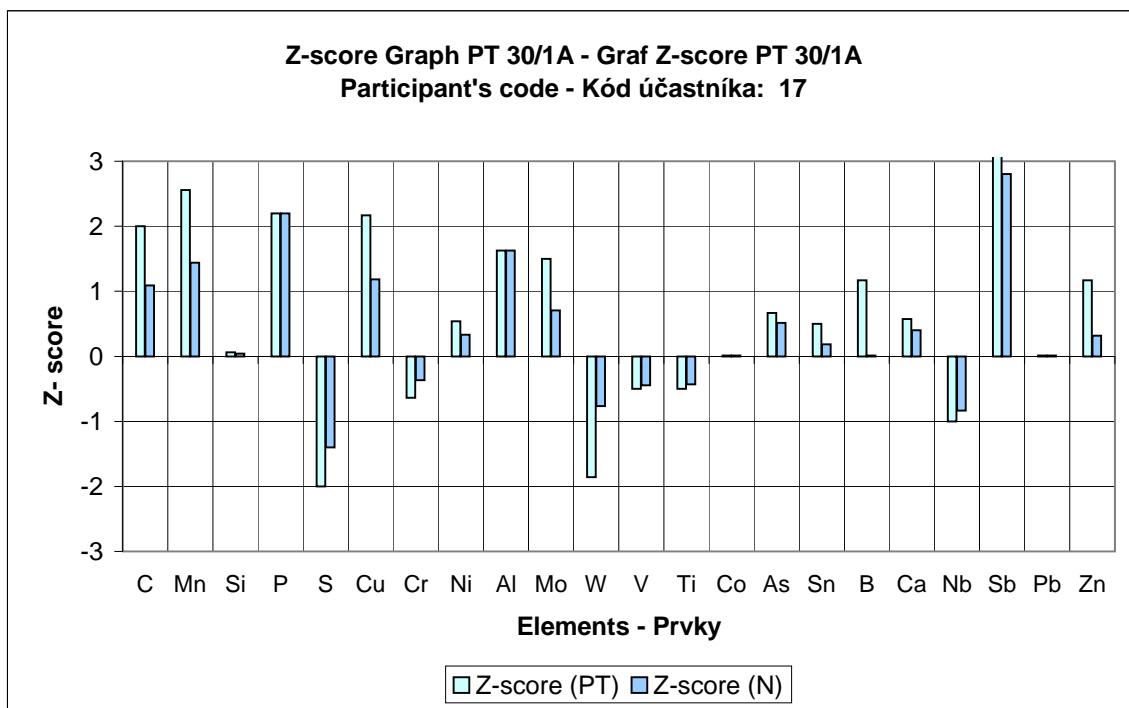

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL  
1. máje 432  
735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 18 - Z-score účastníka s kódem 18**

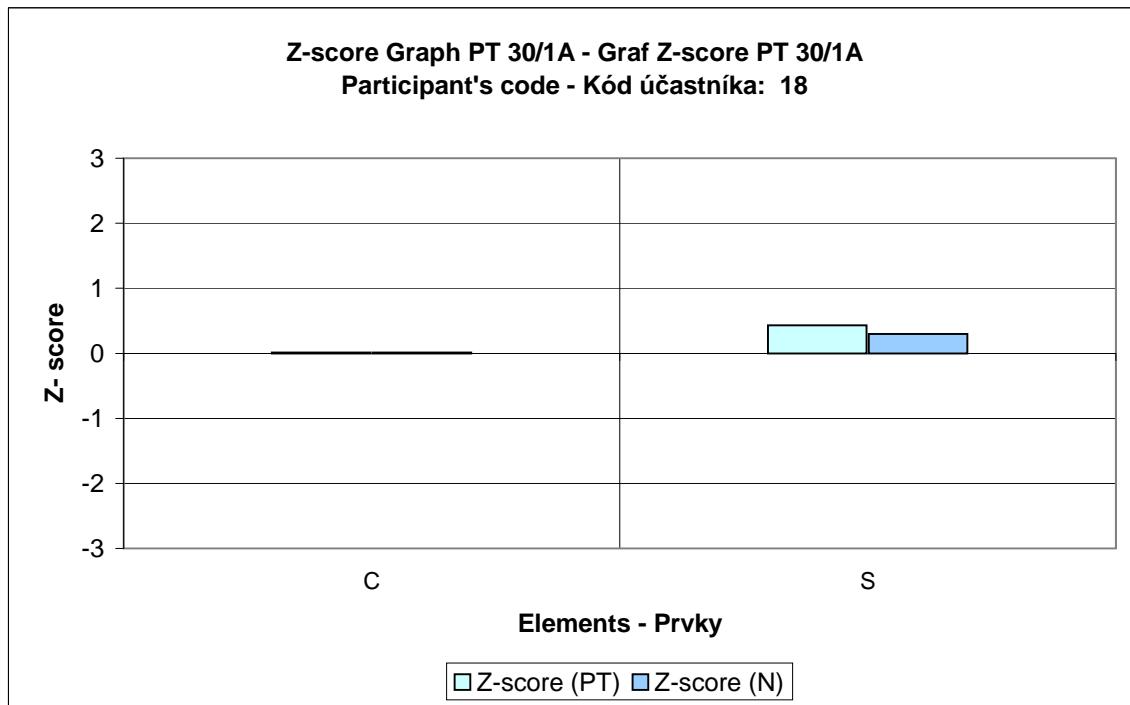

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 19 - Z-score účastníka s kódem 19**

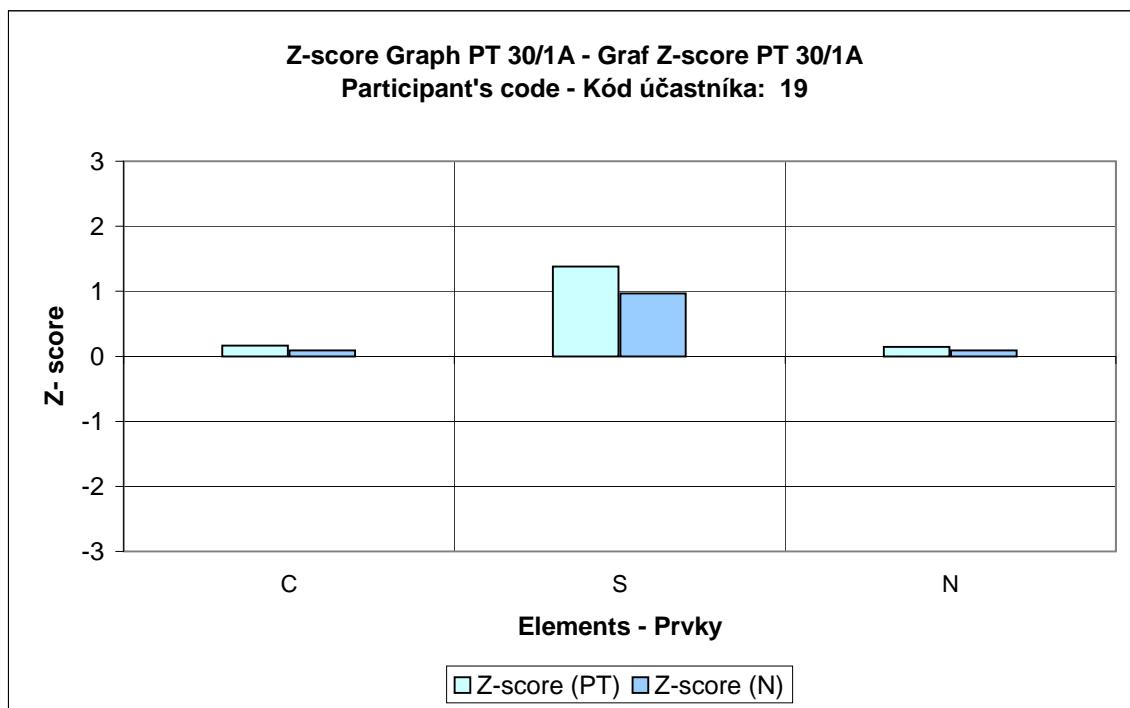

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 20 - Z-score účastníka s kódem 20**

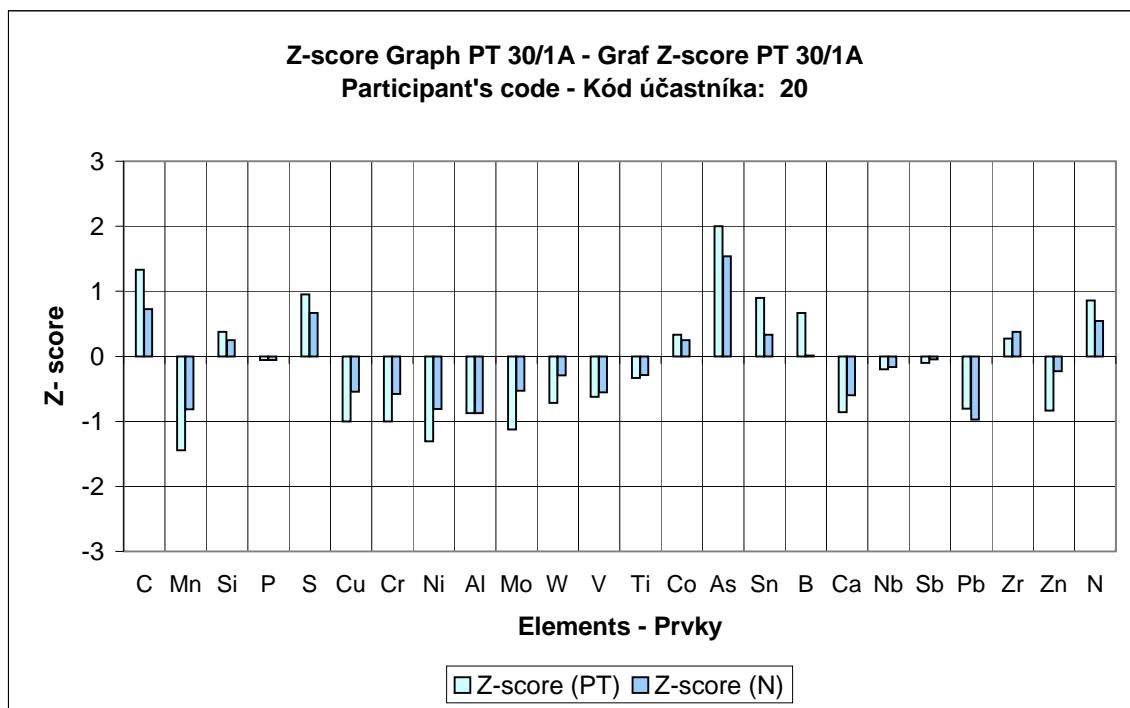

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

## Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A

### Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A

### Z-scores of the participant with code 21 - Z-score účastníka s kódem 21

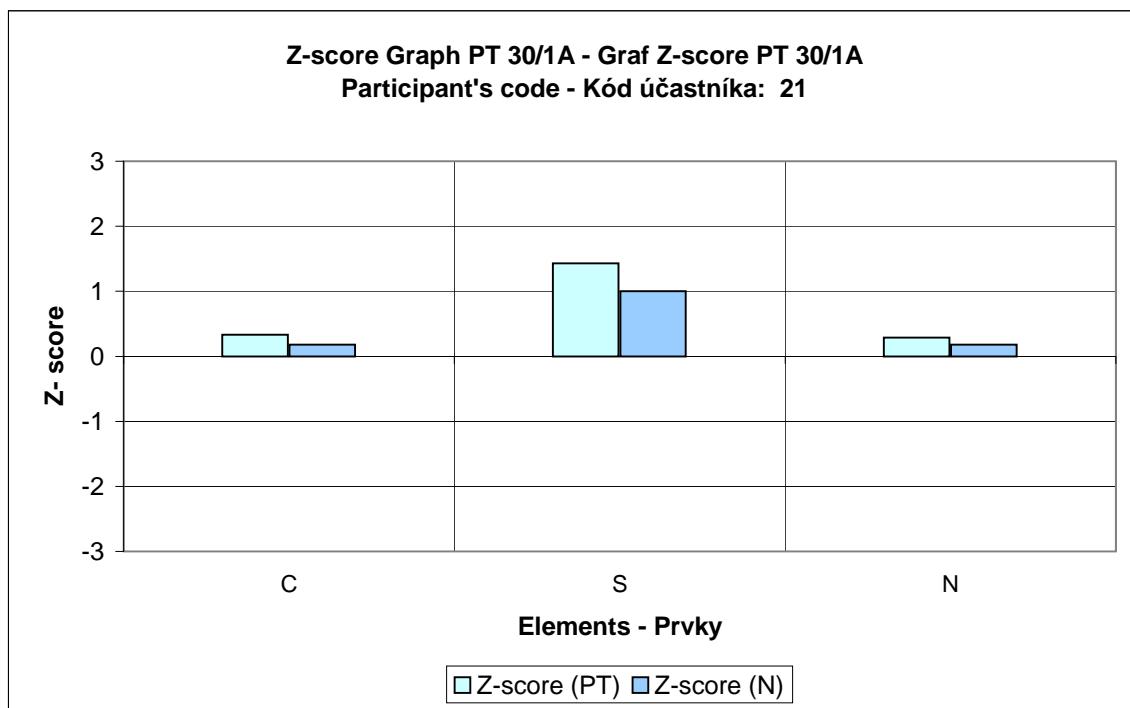

#### Comments Poznámky

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 22 - Z-score účastníka s kódem 22**

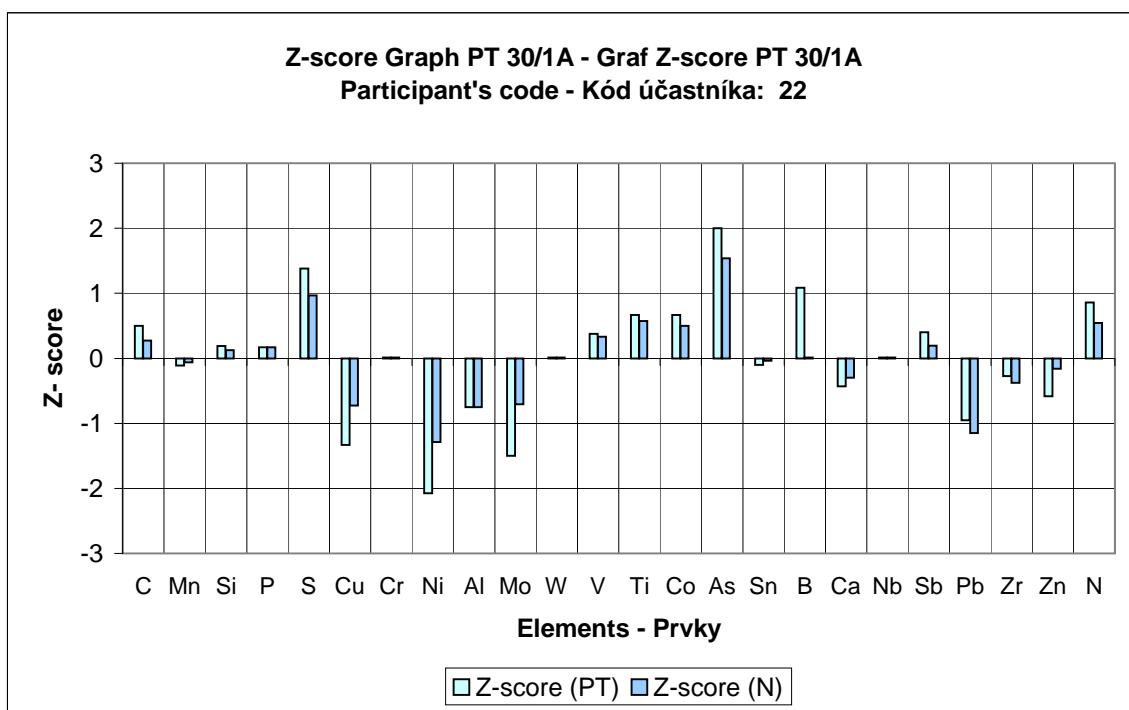

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 23 - Z-score účastníka s kódem 23**

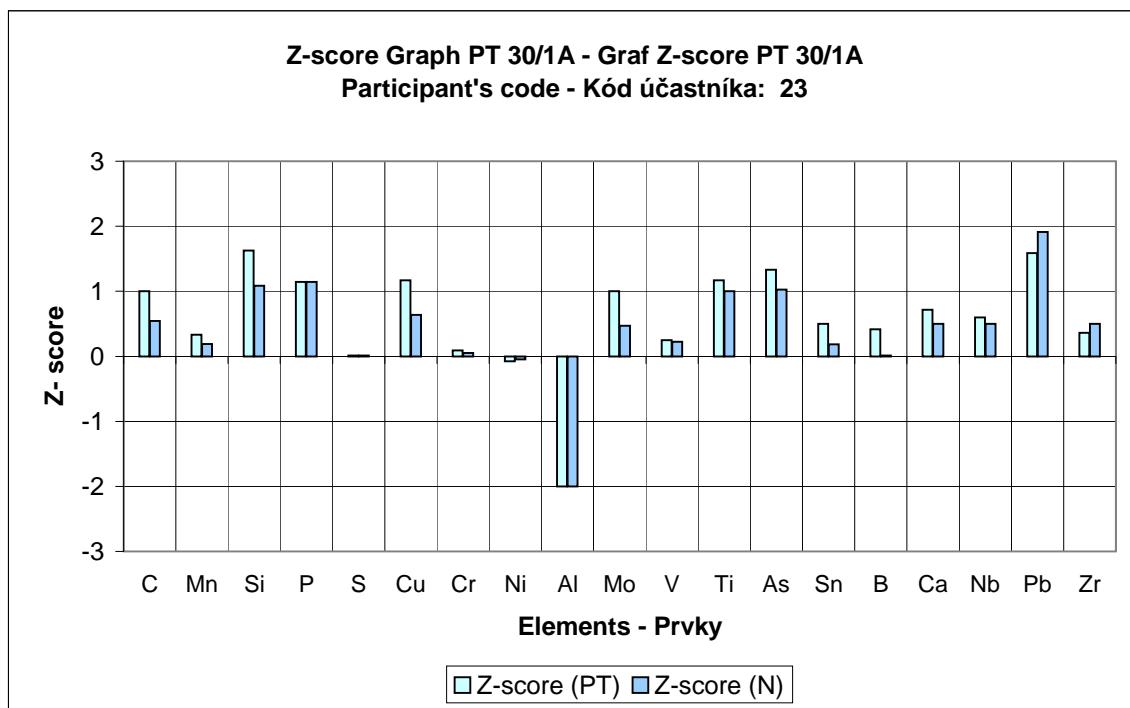

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 24 - Z-score účastníka s kódem 24**

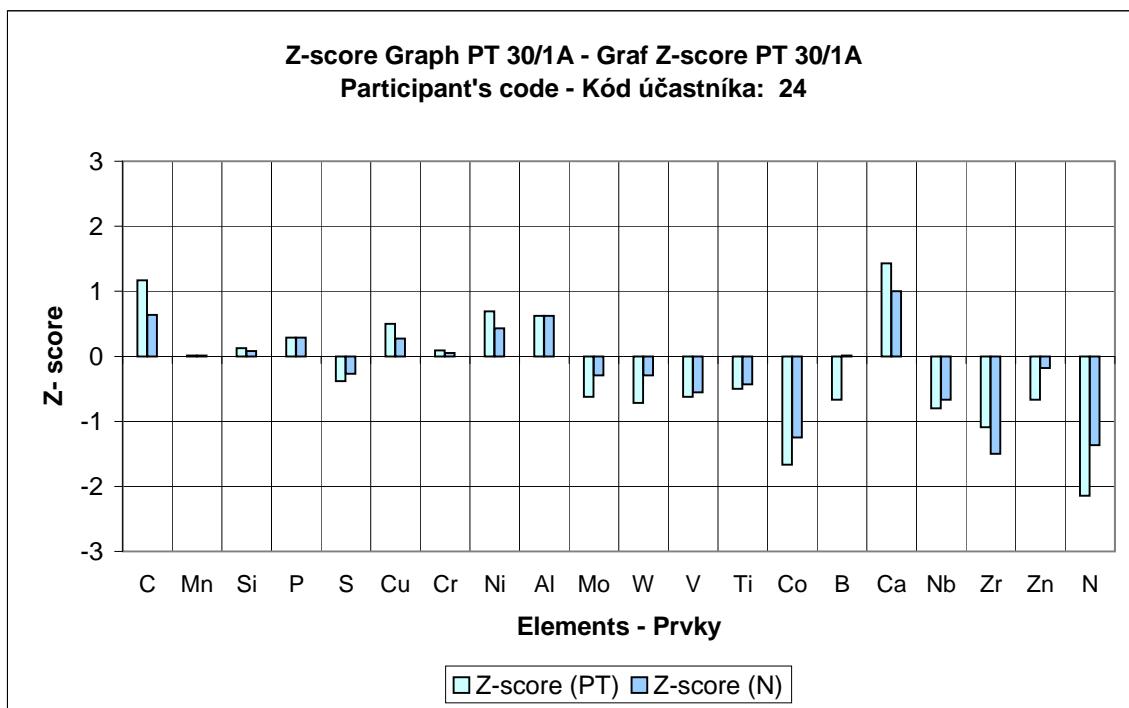

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 25 - Z-score účastníka s kódem 25**

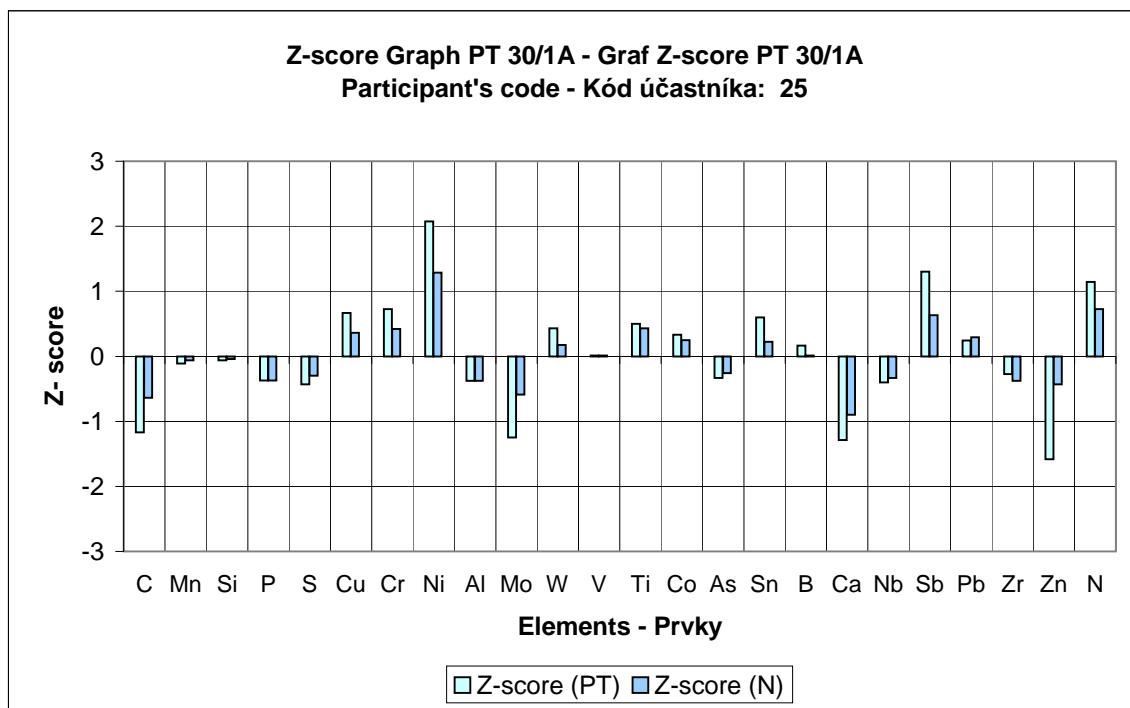

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 26 - Z-score účastníka s kódem 26**

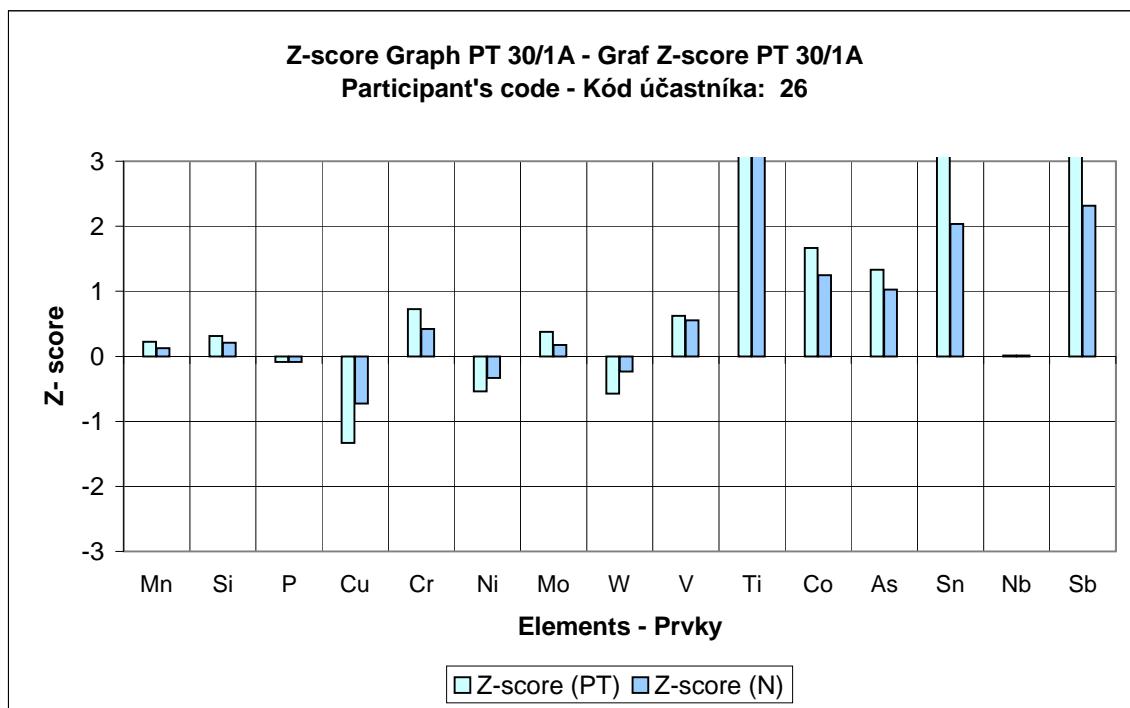

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 27 - Z-score účastníka s kódem 27**

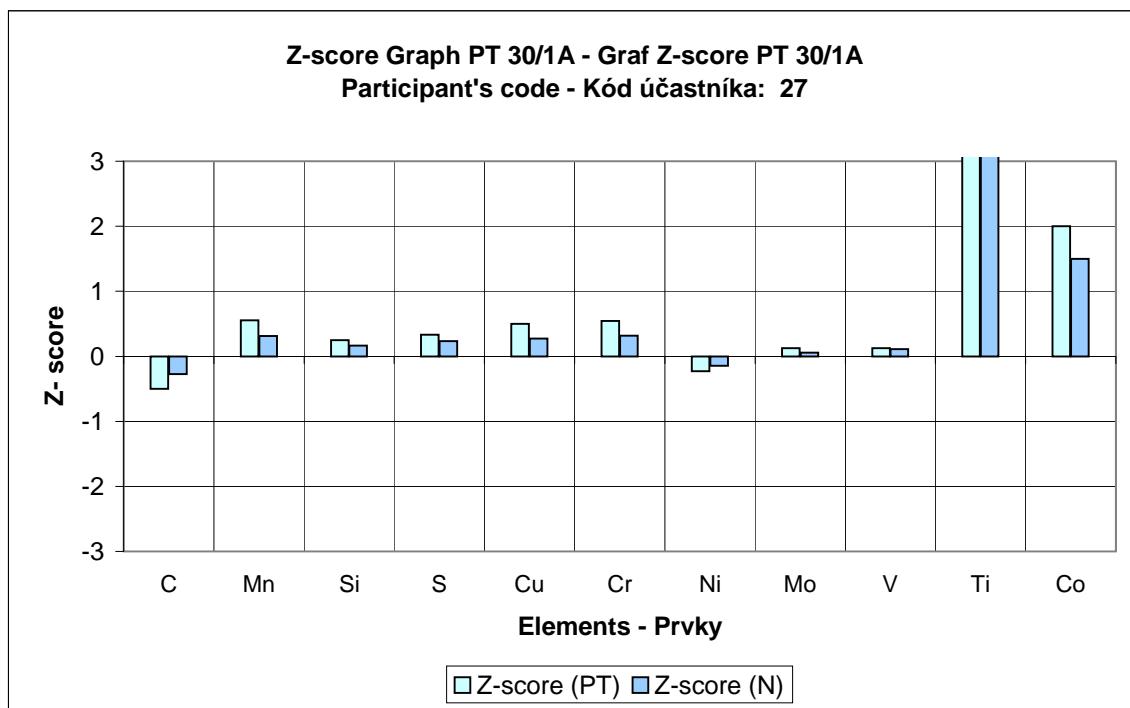

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 28 - Z-score účastníka s kódem 28**

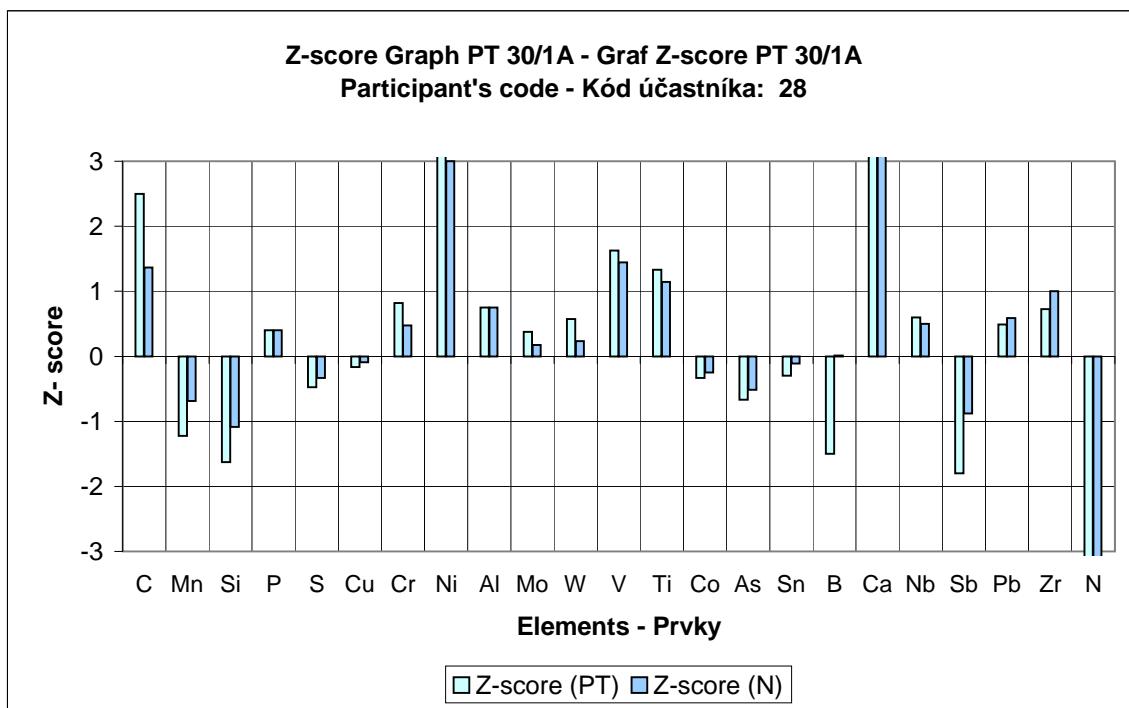

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 29 - Z-score účastníka s kódem 29**

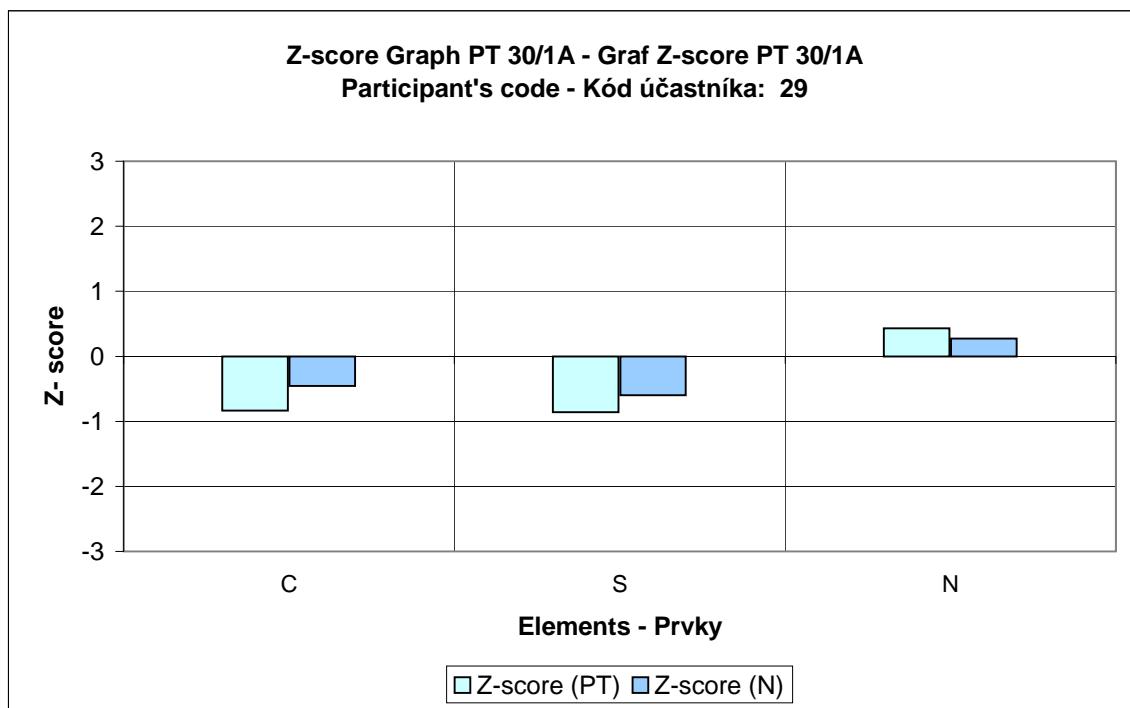

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 30 - Z-score účastníka s kódem 30**

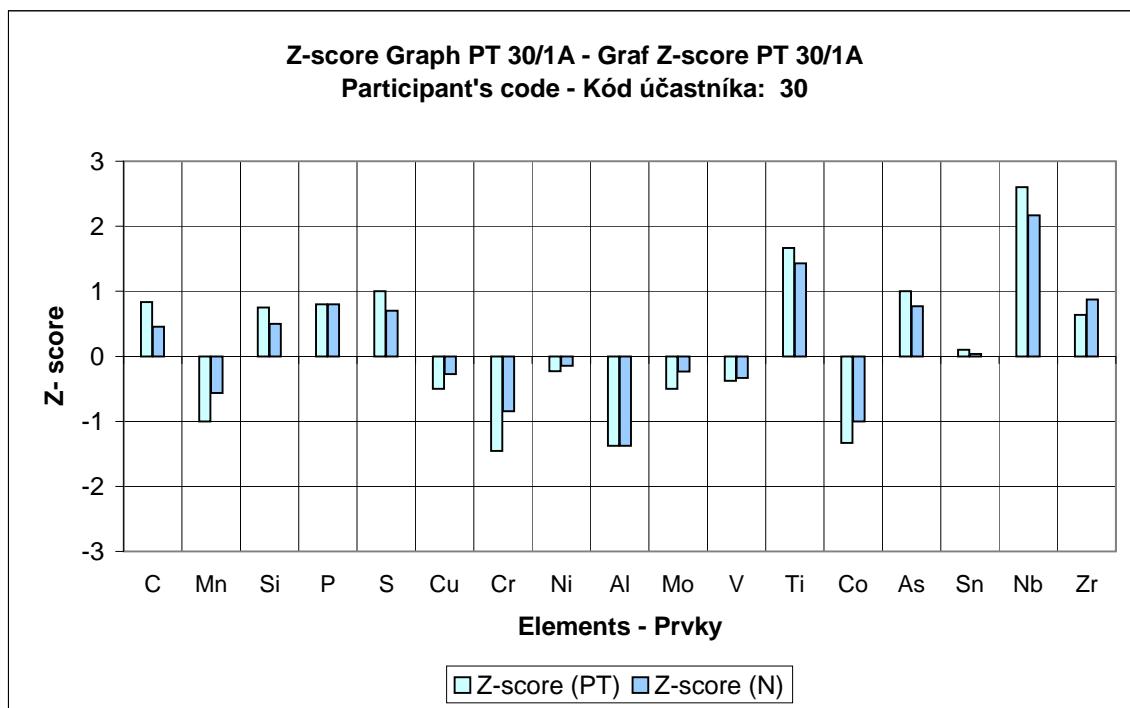

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 31 - Z-score účastníka s kódem 31**

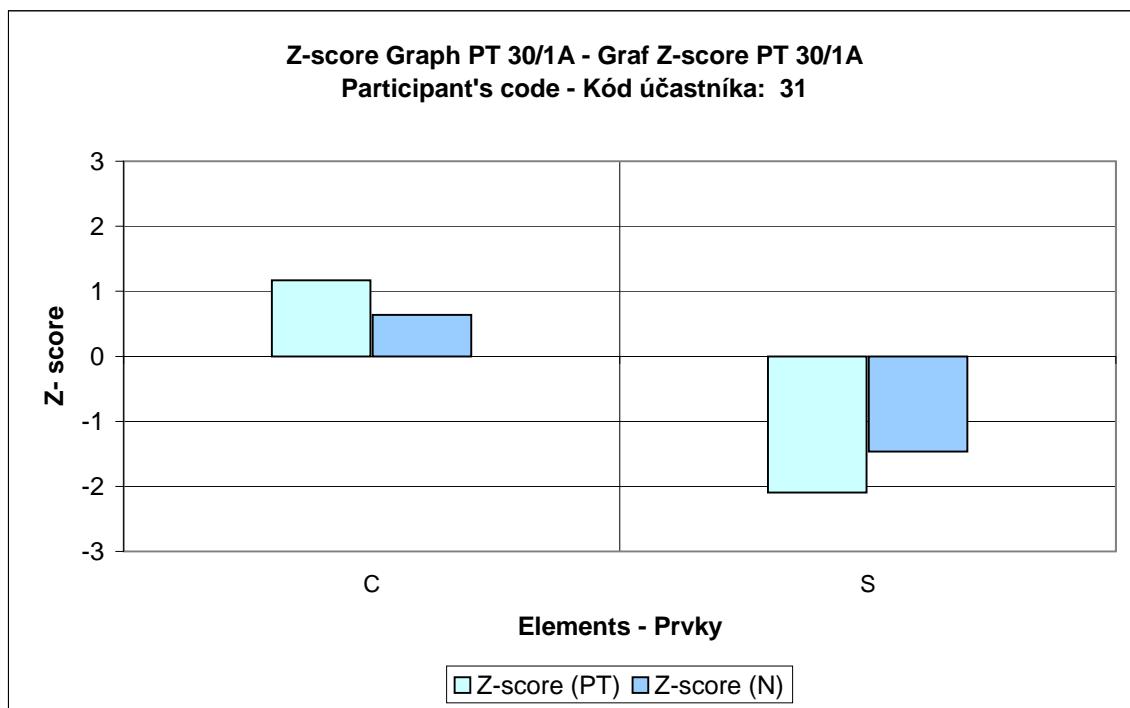

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 32 - Z-score účastníka s kódem 32**

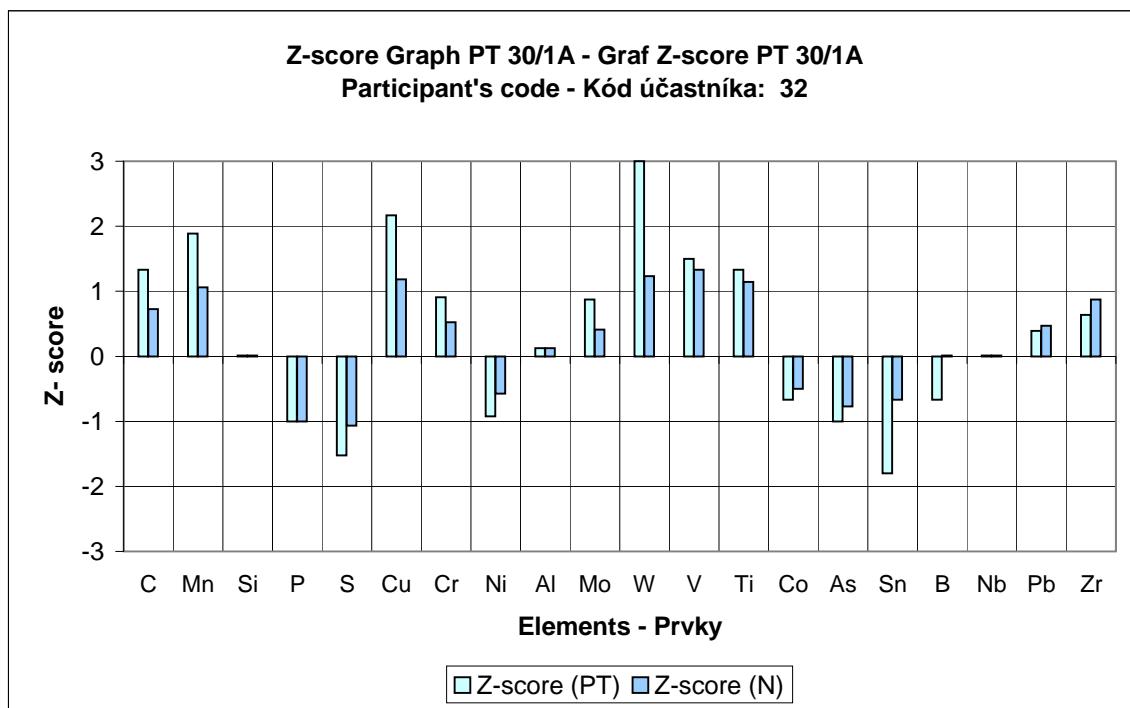

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 33 - Z-score účastníka s kódem 33**

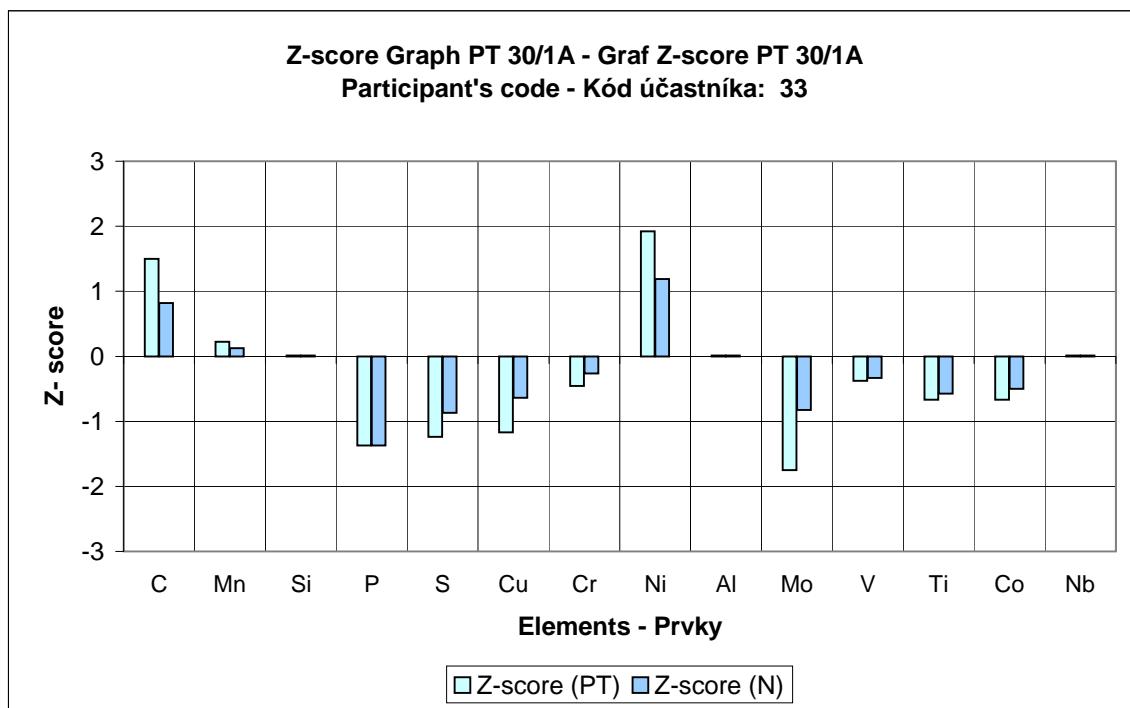

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 34 - Z-score účastníka s kódem 34**

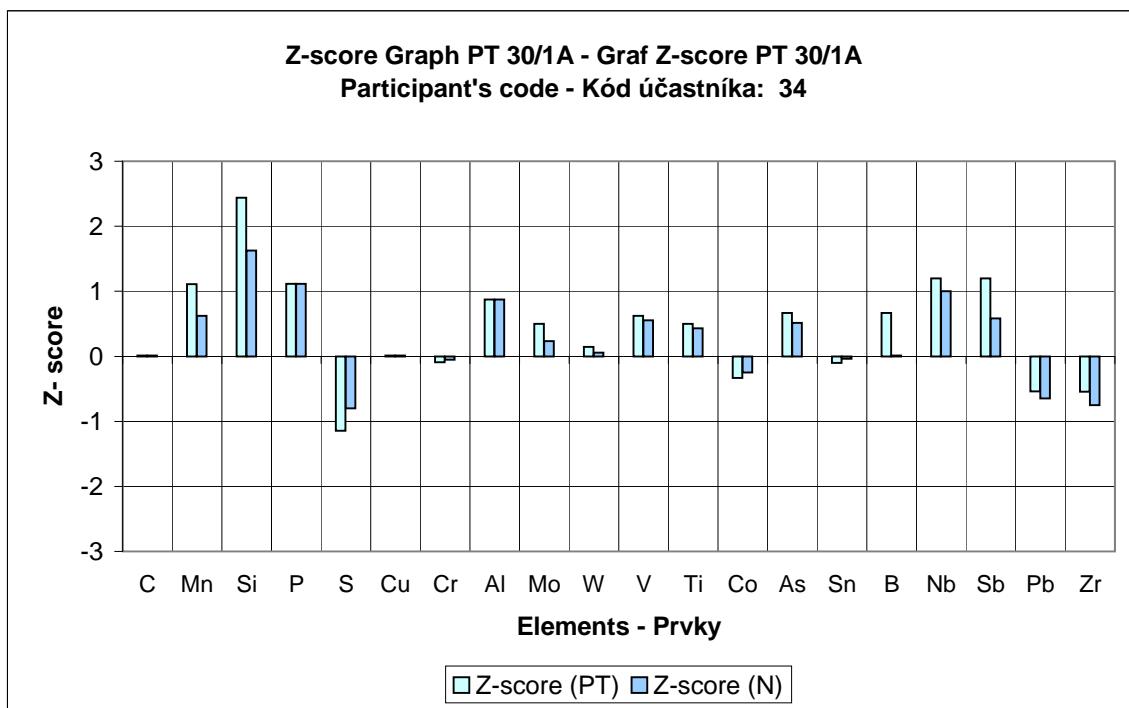

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 35 - Z-score účastníka s kódem 35**

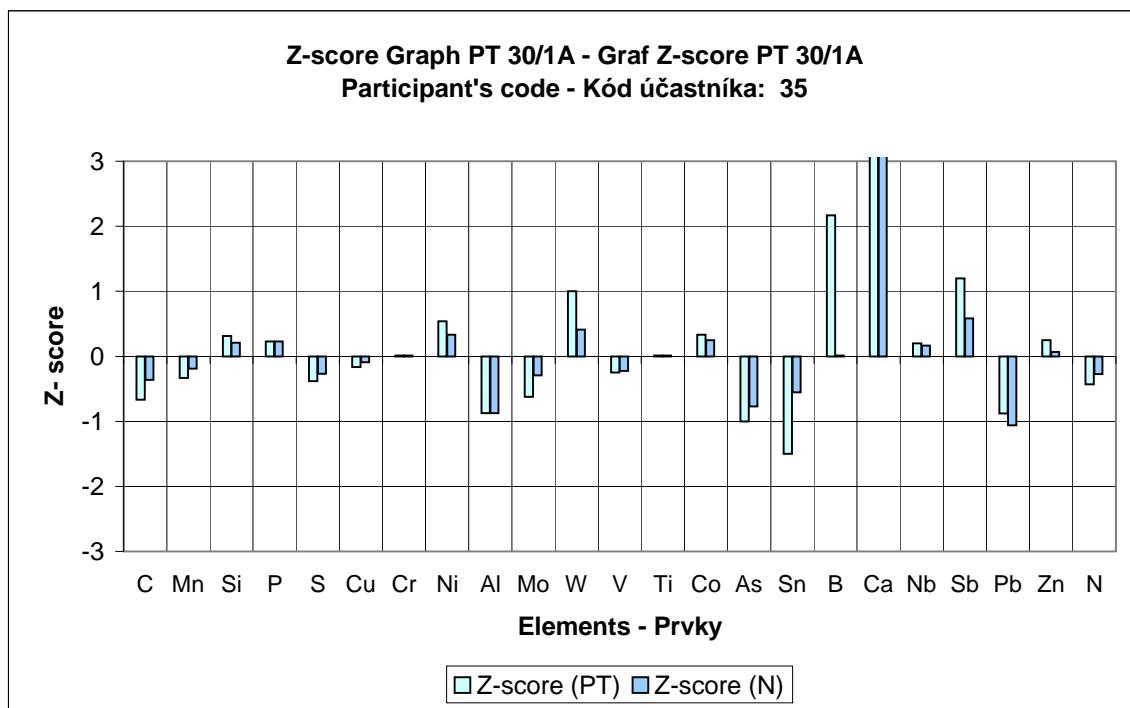

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$       Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$       Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 36 - Z-score účastníka s kódem 36**

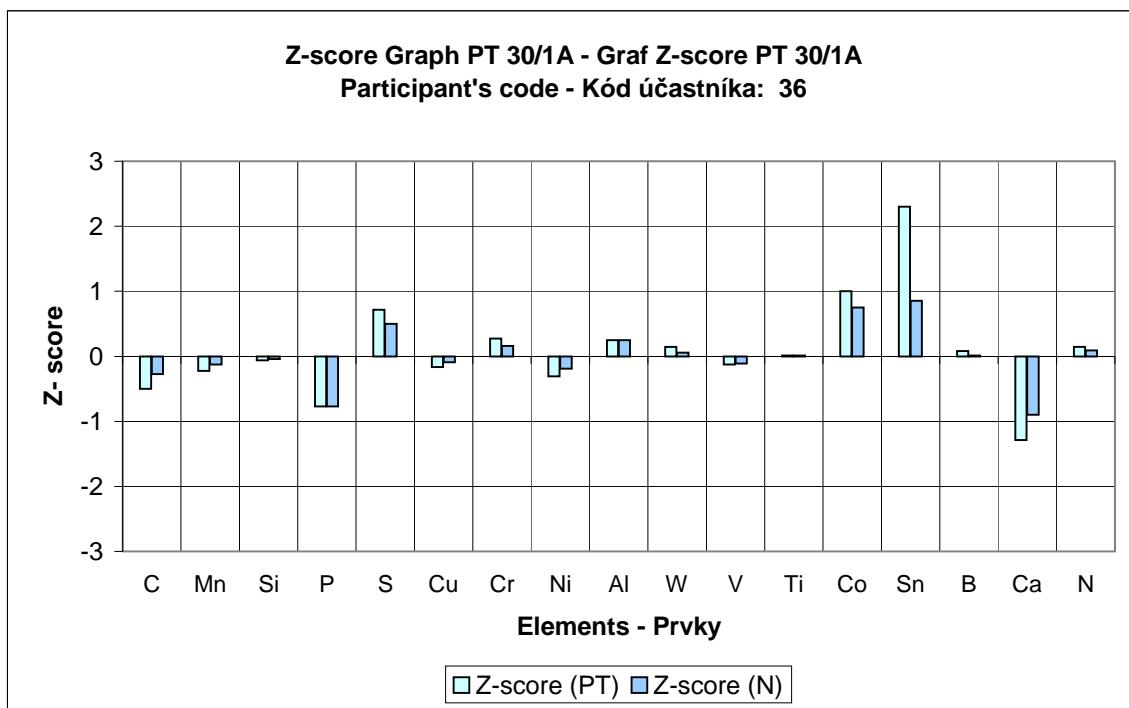

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 37 - Z-score účastníka s kódem 37**

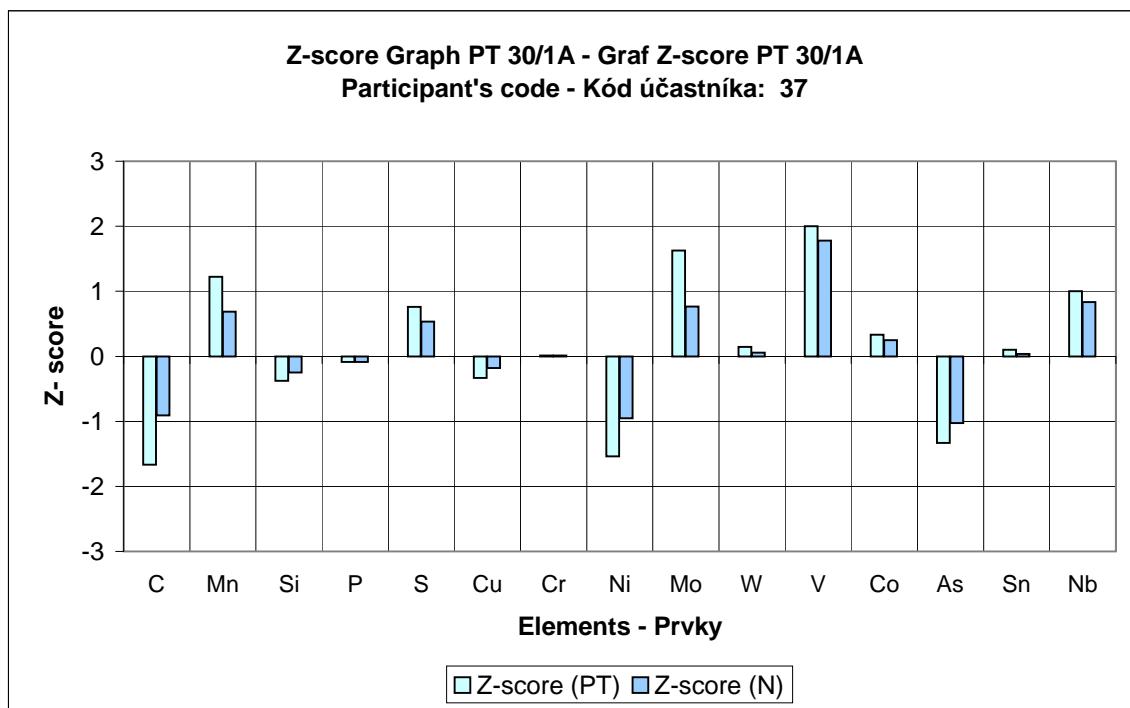

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 38 - Z-score účastníka s kódem 38**

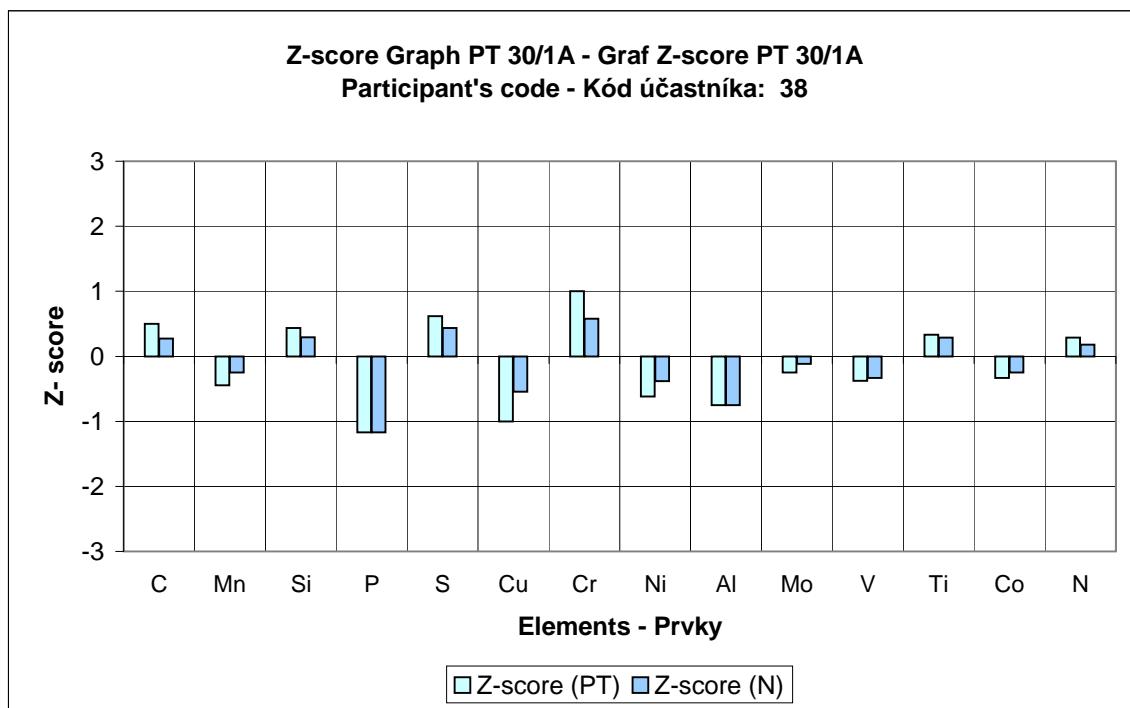

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 39 - Z-score účastníka s kódem 39**

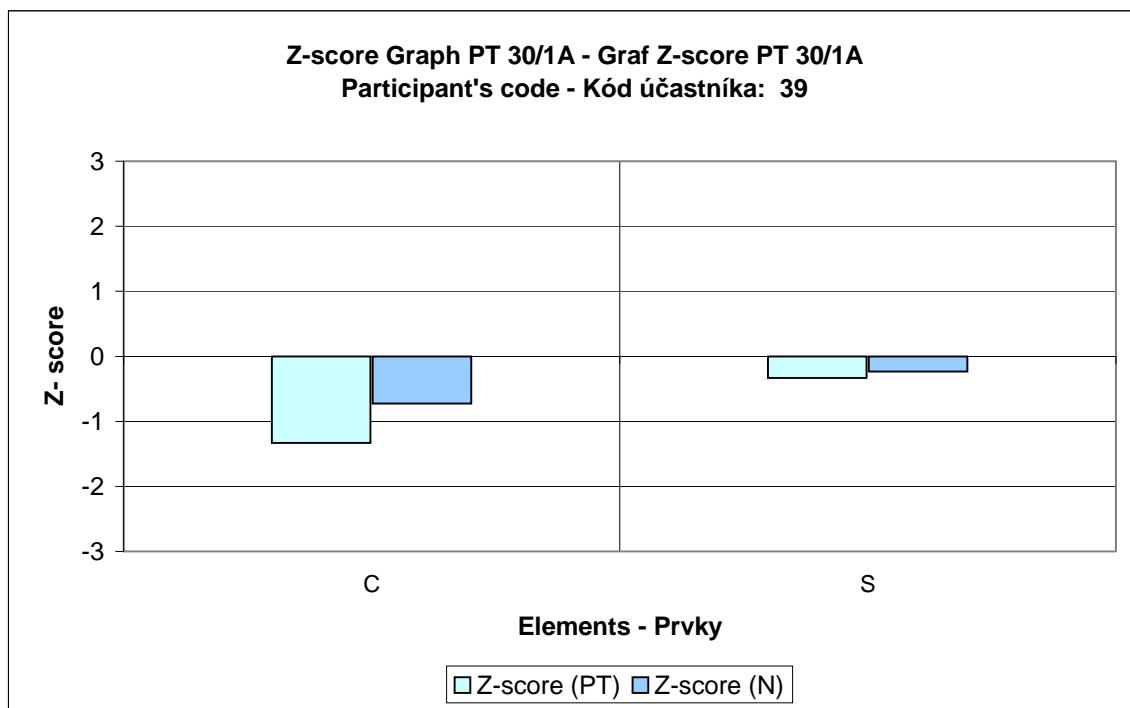

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 40 - Z-score účastníka s kódem 40**

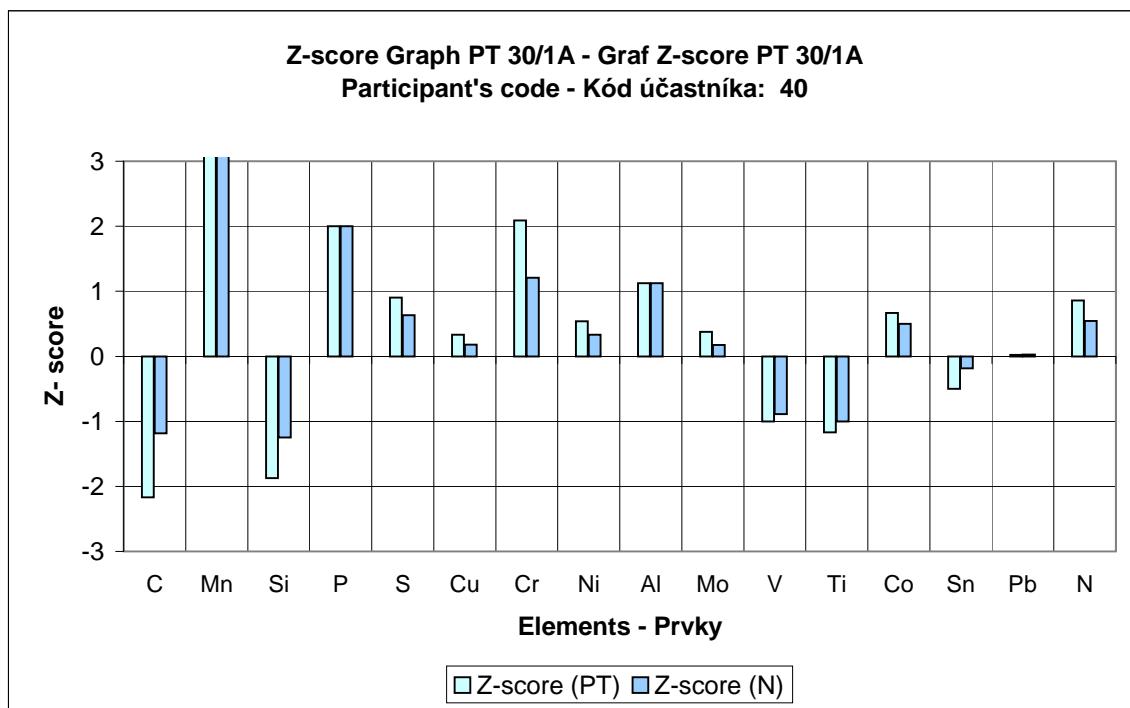

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 41 - Z-score účastníka s kódem 41**

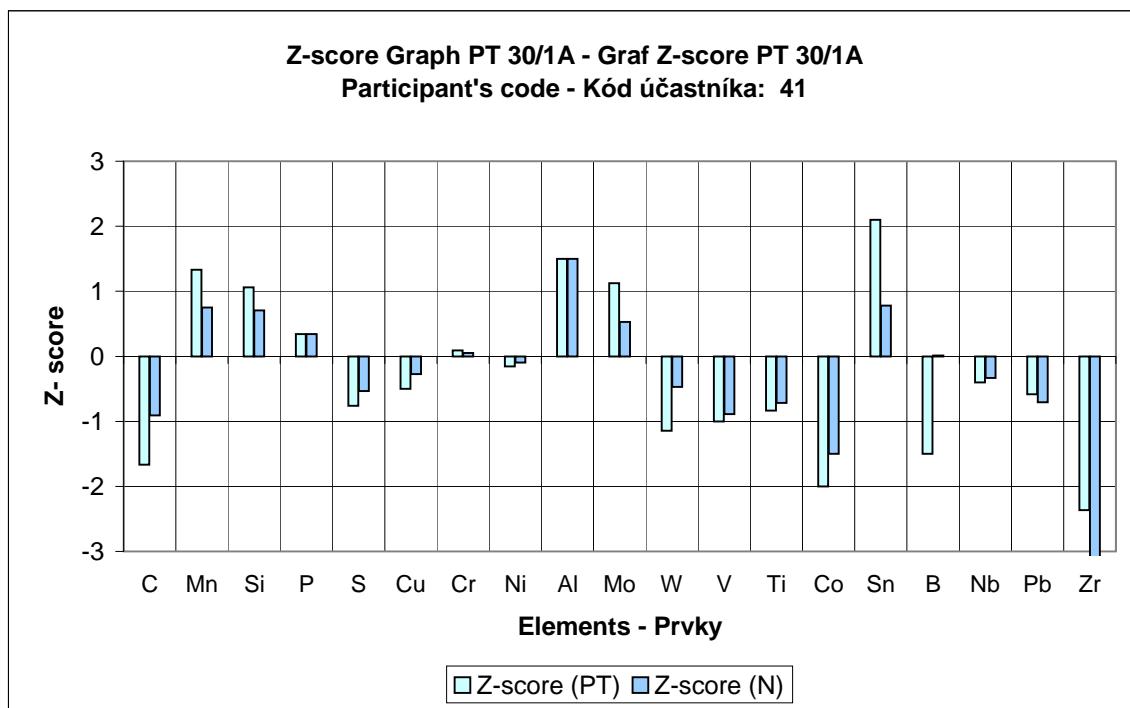

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 42 - Z-score účastníka s kódem 42**

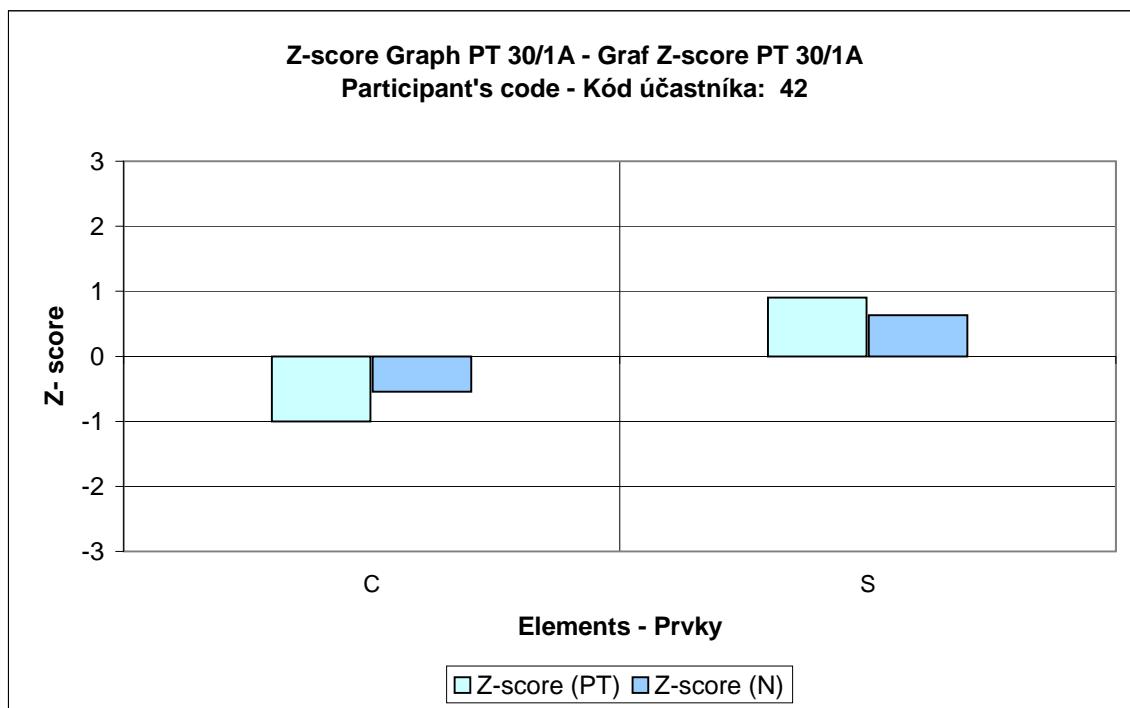

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 43 - Z-score účastníka s kódem 43**

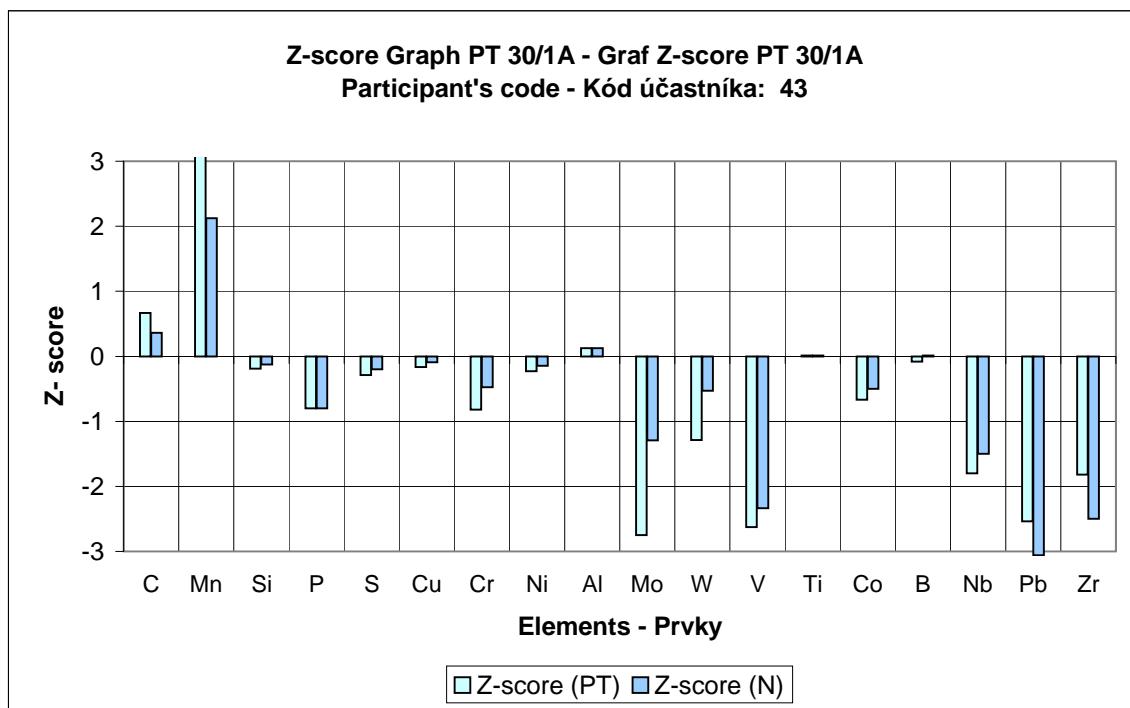

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 44 - Z-score účastníka s kódem 44**

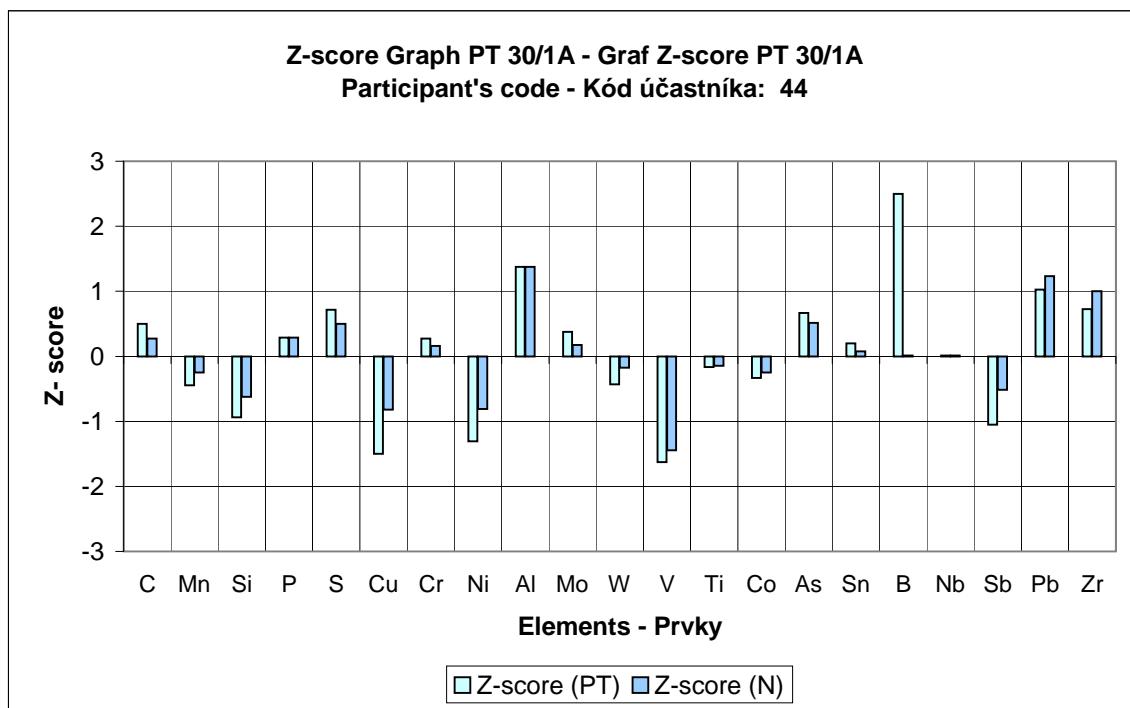

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 45 - Z-score účastníka s kódem 45**

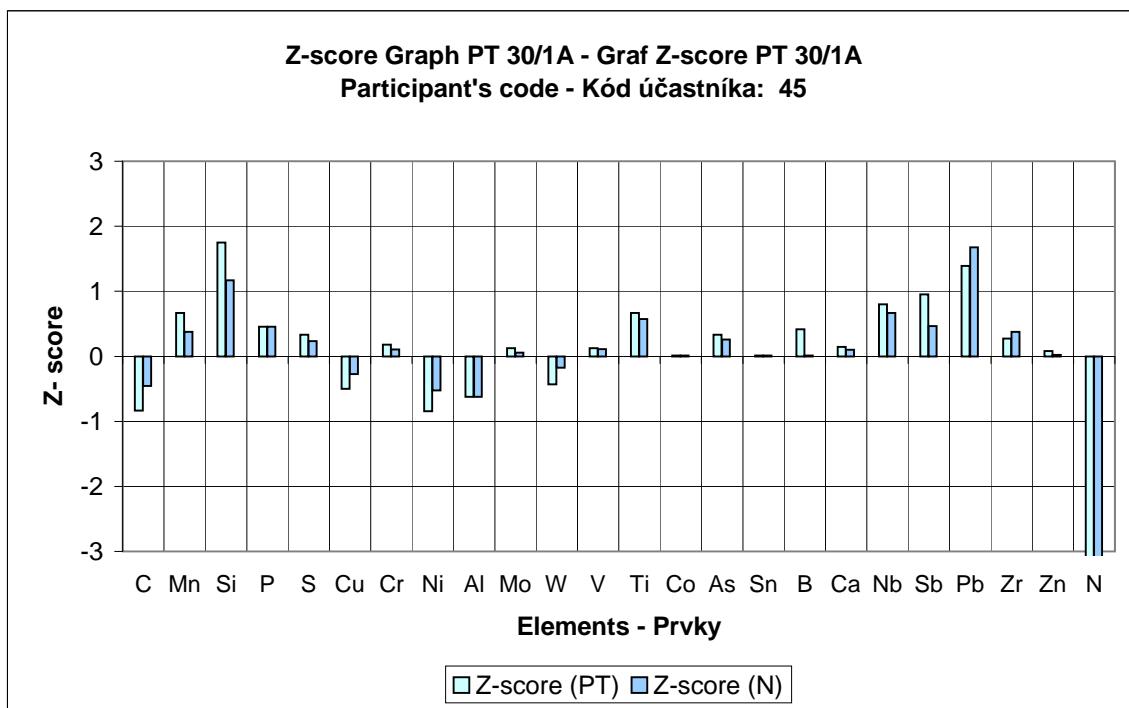

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 46 - Z-score účastníka s kódem 46**

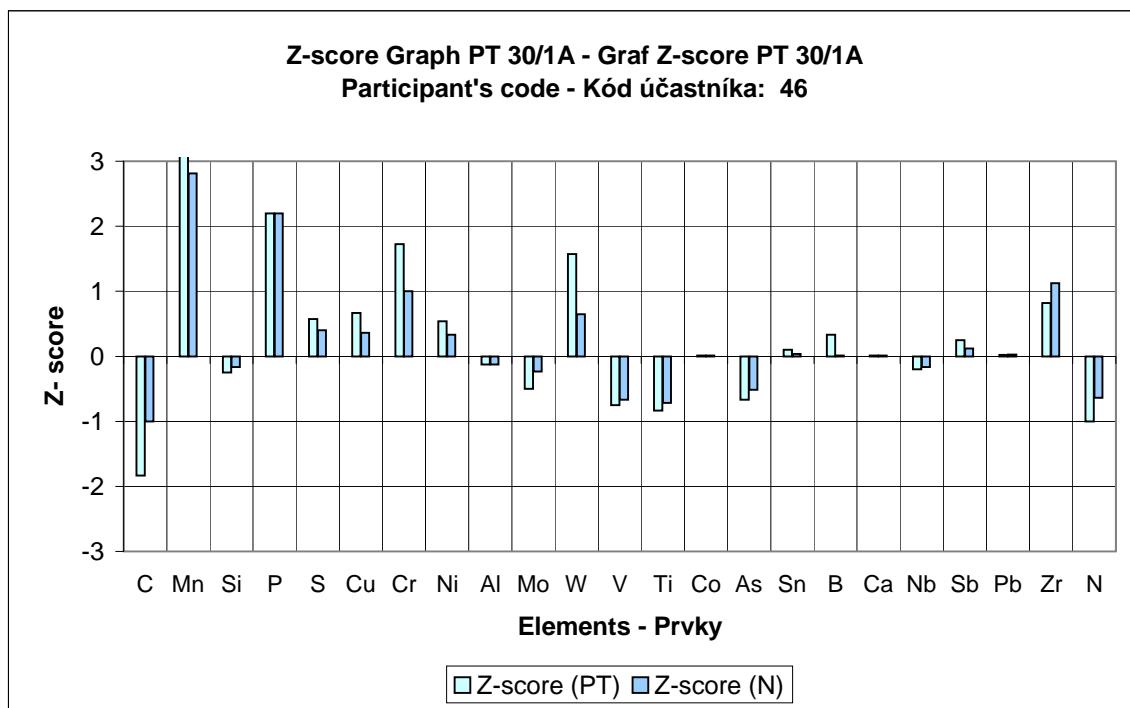

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 47 - Z-score účastníka s kódem 47**

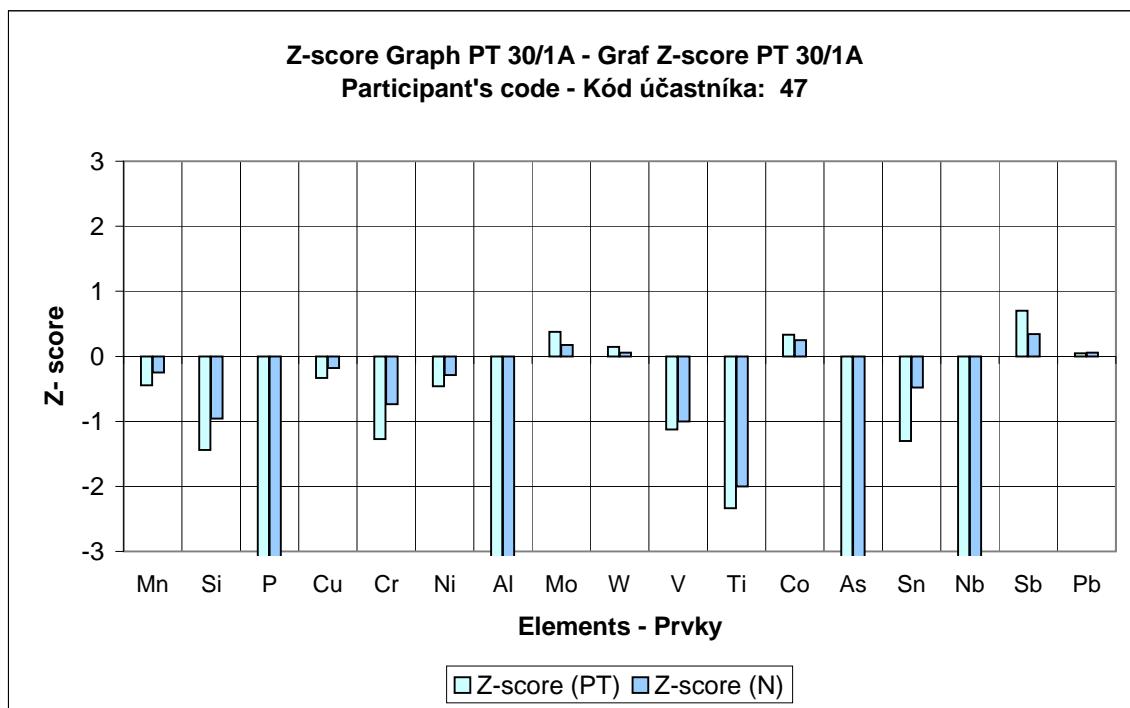

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 48 - Z-score účastníka s kódem 48**

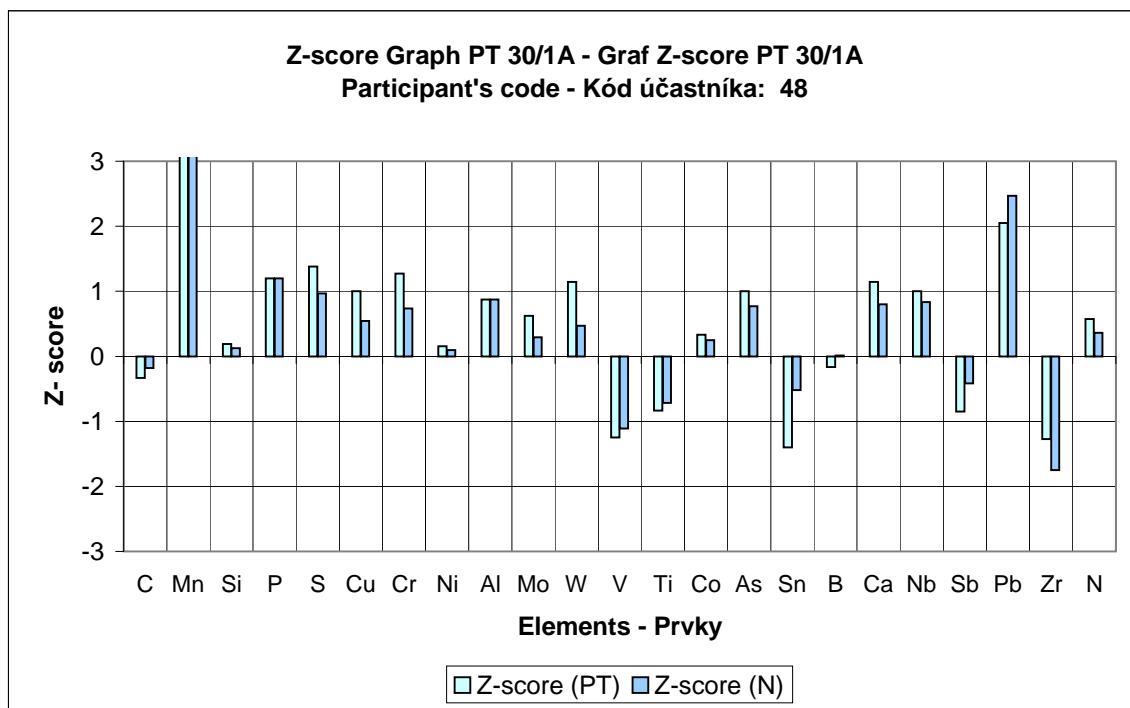

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 49 - Z-score účastníka s kódem 49**

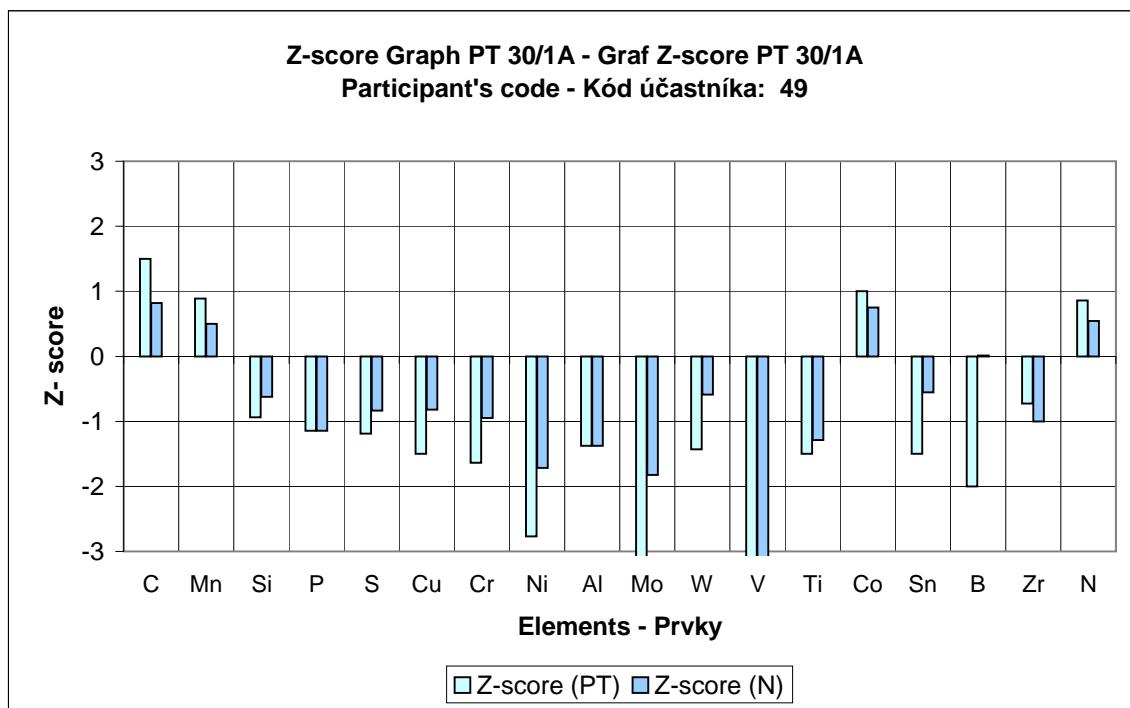

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL  
1. máje 432  
735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 50 - Z-score účastníka s kódem 50**

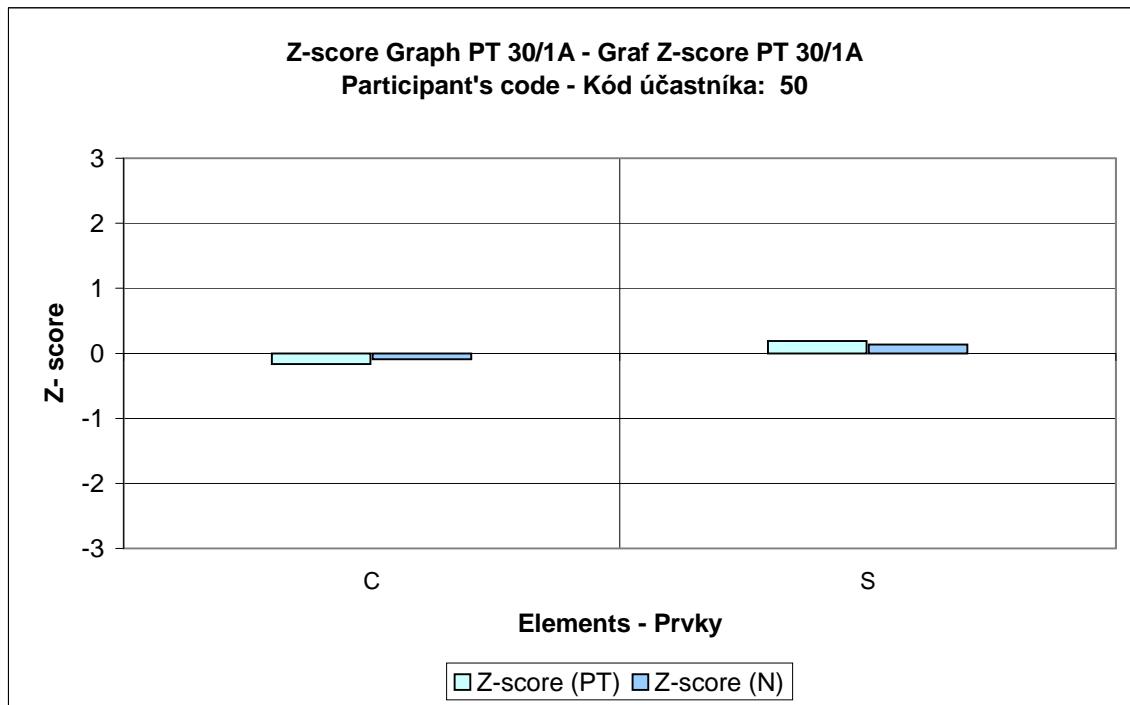

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 51 - Z-score účastníka s kódem 51**

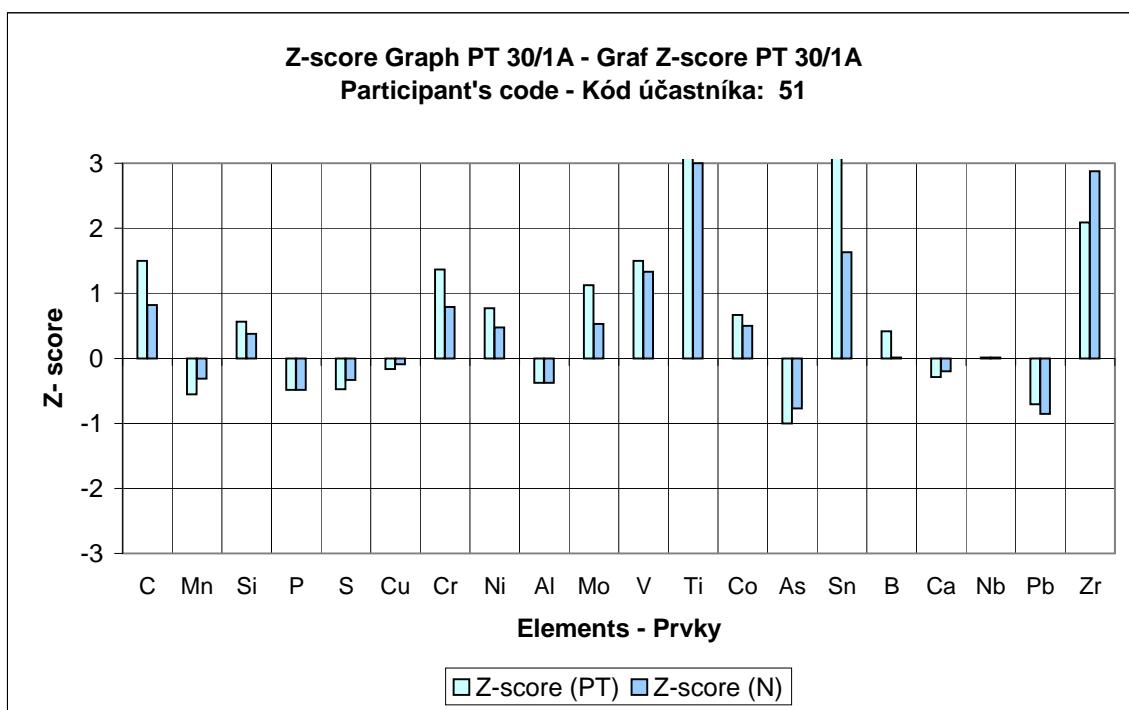

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL  
1. máje 432  
735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 52 - Z-score účastníka s kódem 52**

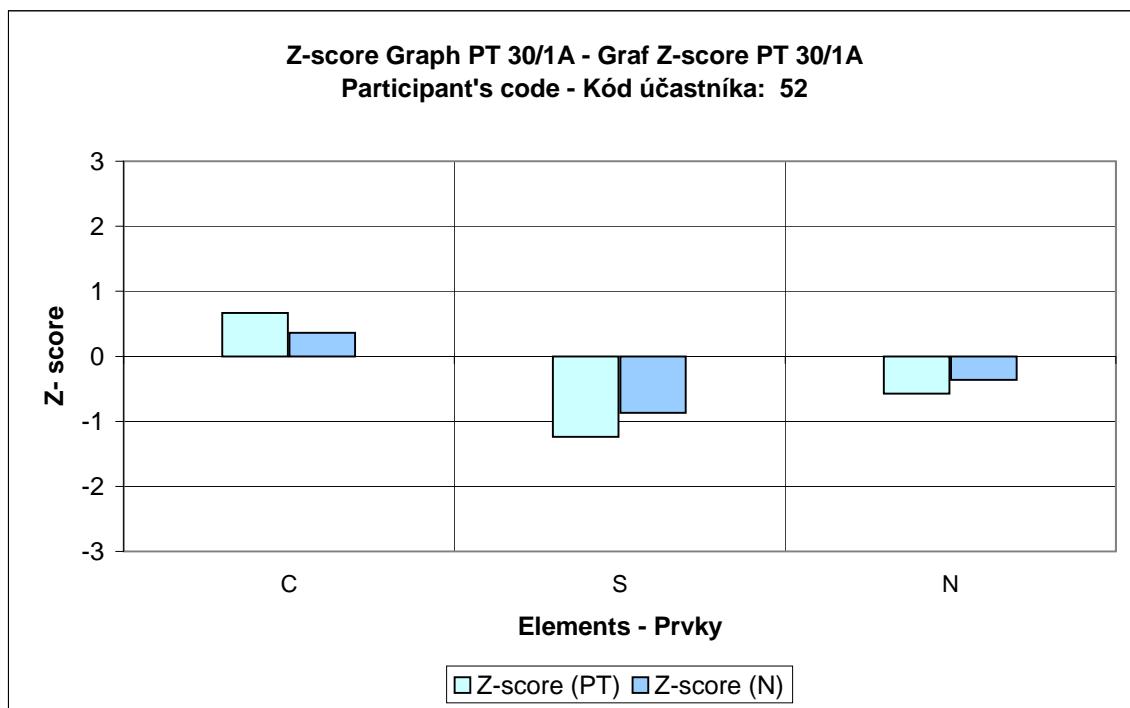

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 53 - Z-score účastníka s kódem 53**

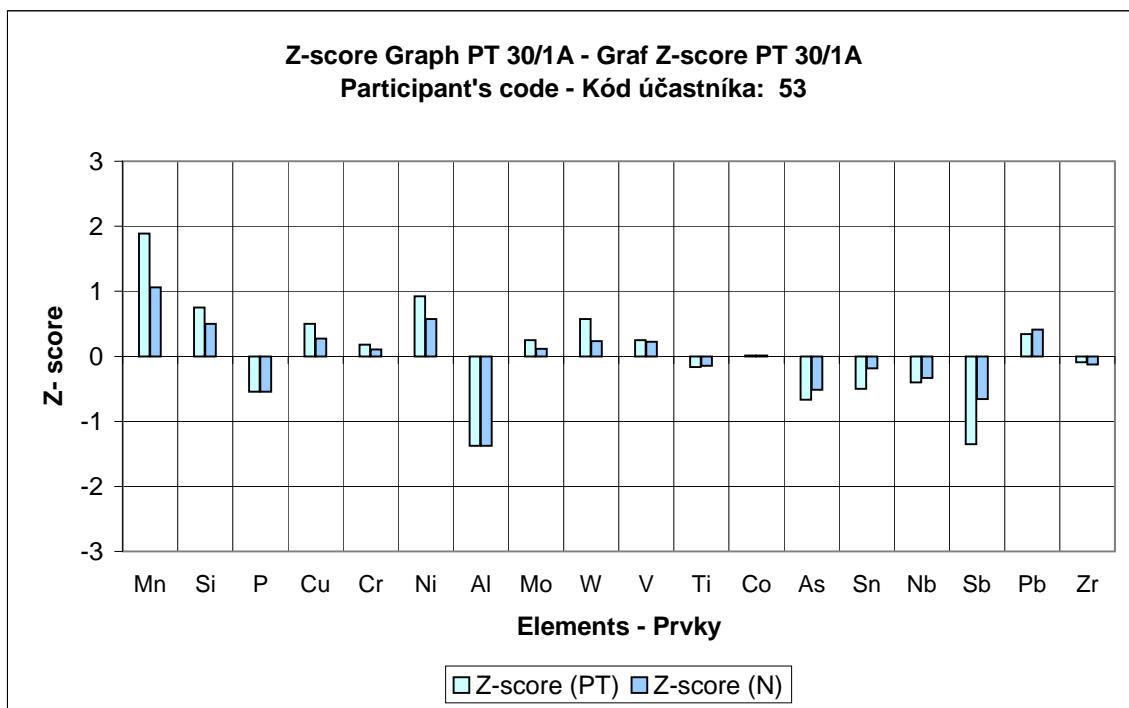

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 54 - Z-score účastníka s kódem 54**

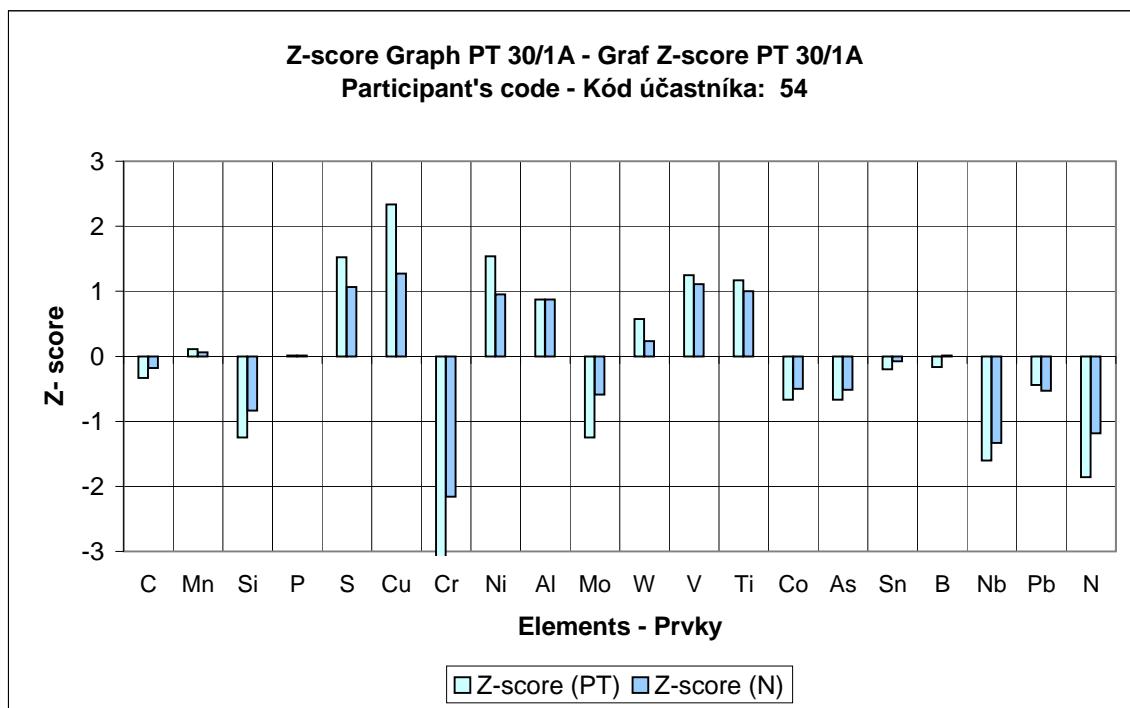

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 55 - Z-score účastníka s kódem 55**

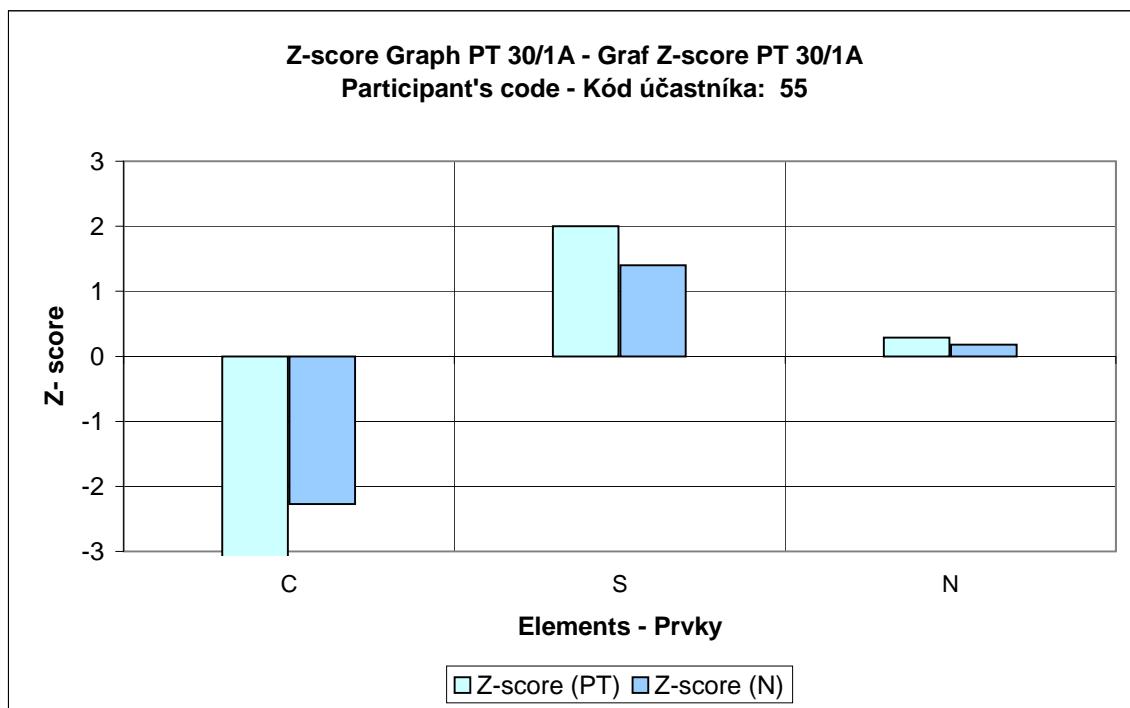

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 56 - Z-score účastníka s kódem 56**

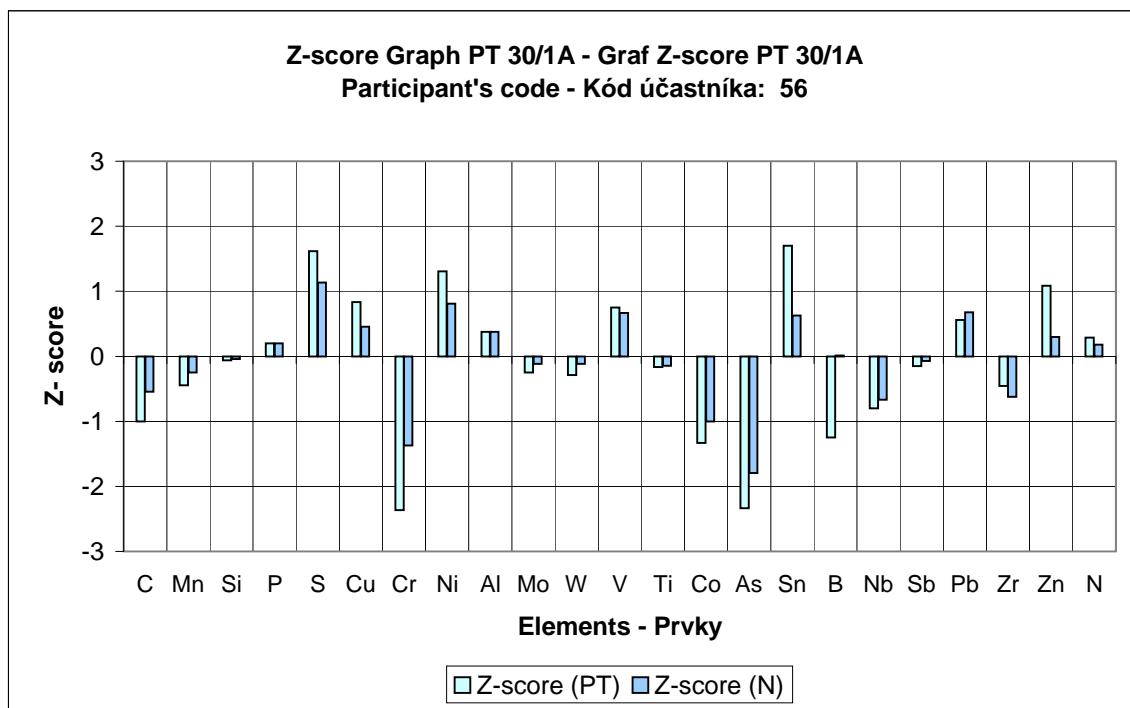

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 57 - Z-score účastníka s kódem 57**

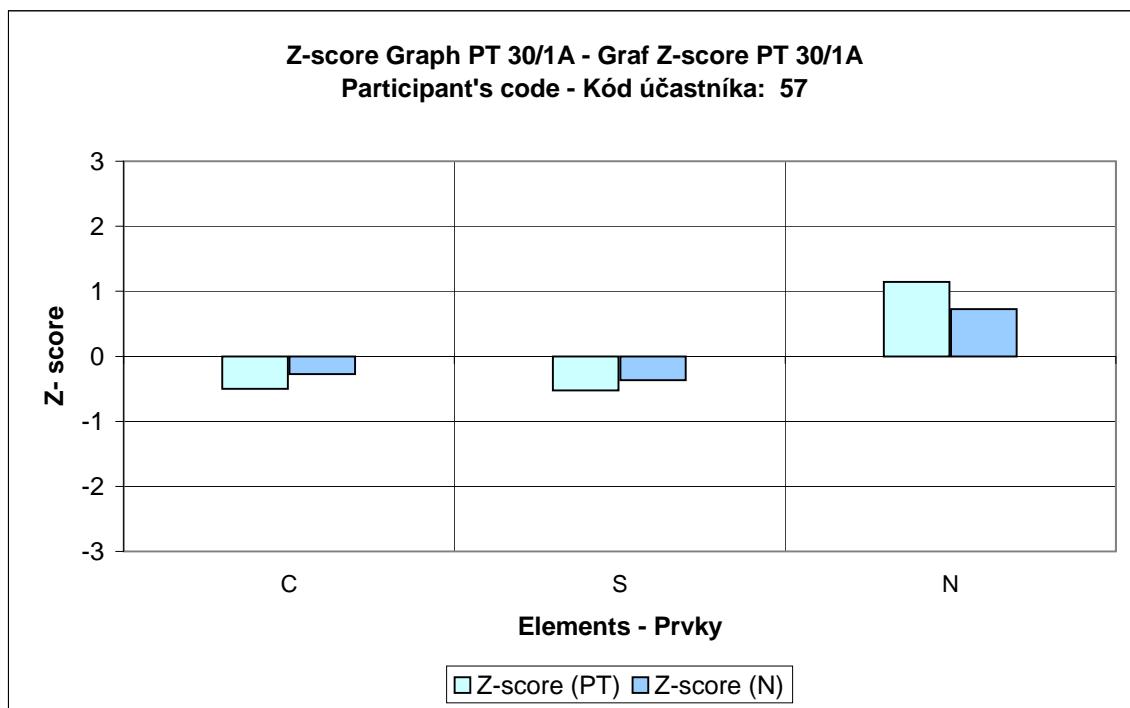

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 58 - Z-score účastníka s kódem 58**

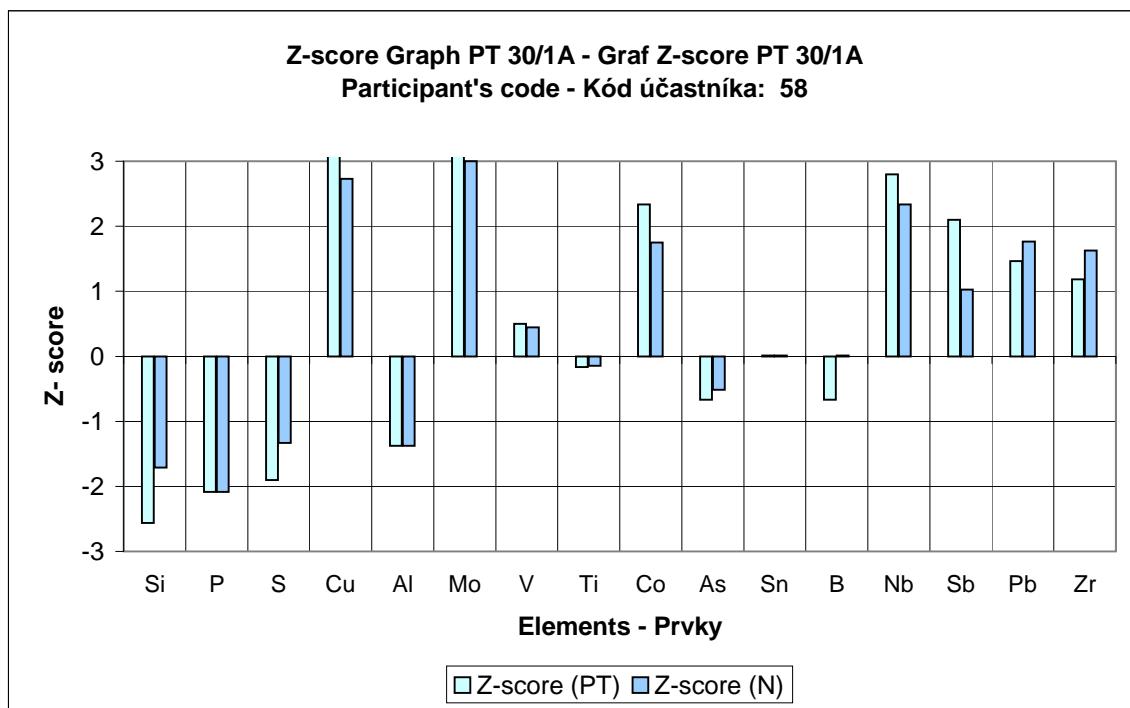

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL  
1. máje 432  
735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 59 - Z-score účastníka s kódem 59**

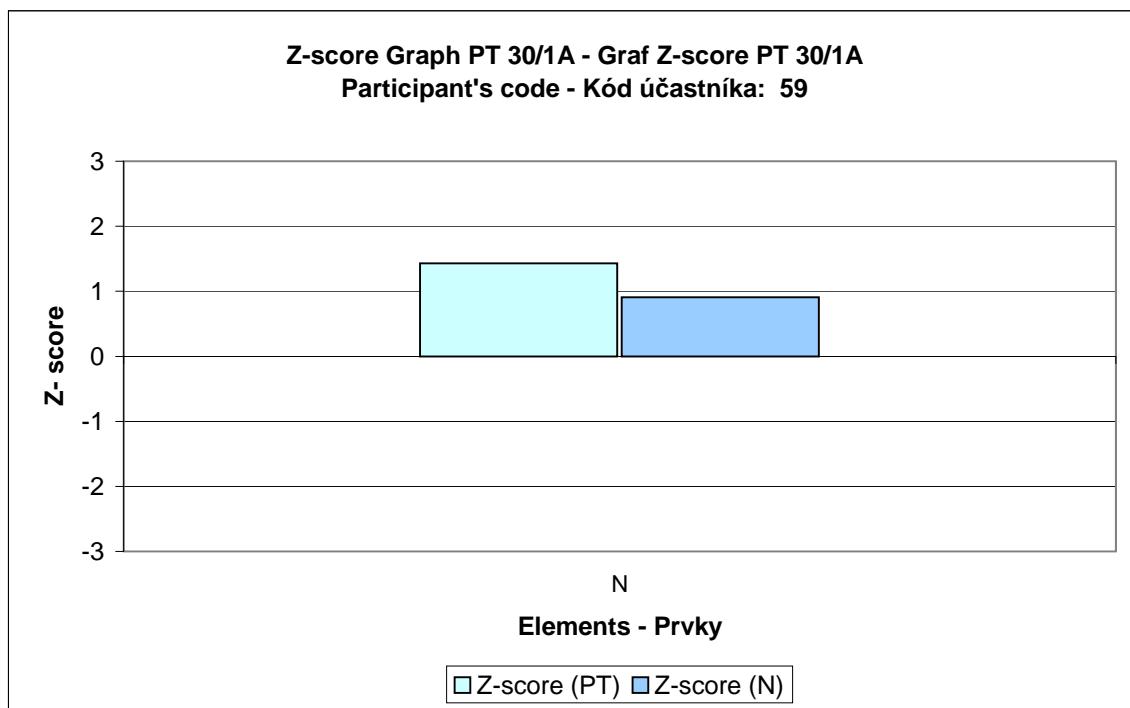

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 60 - Z-score účastníka s kódem 60**

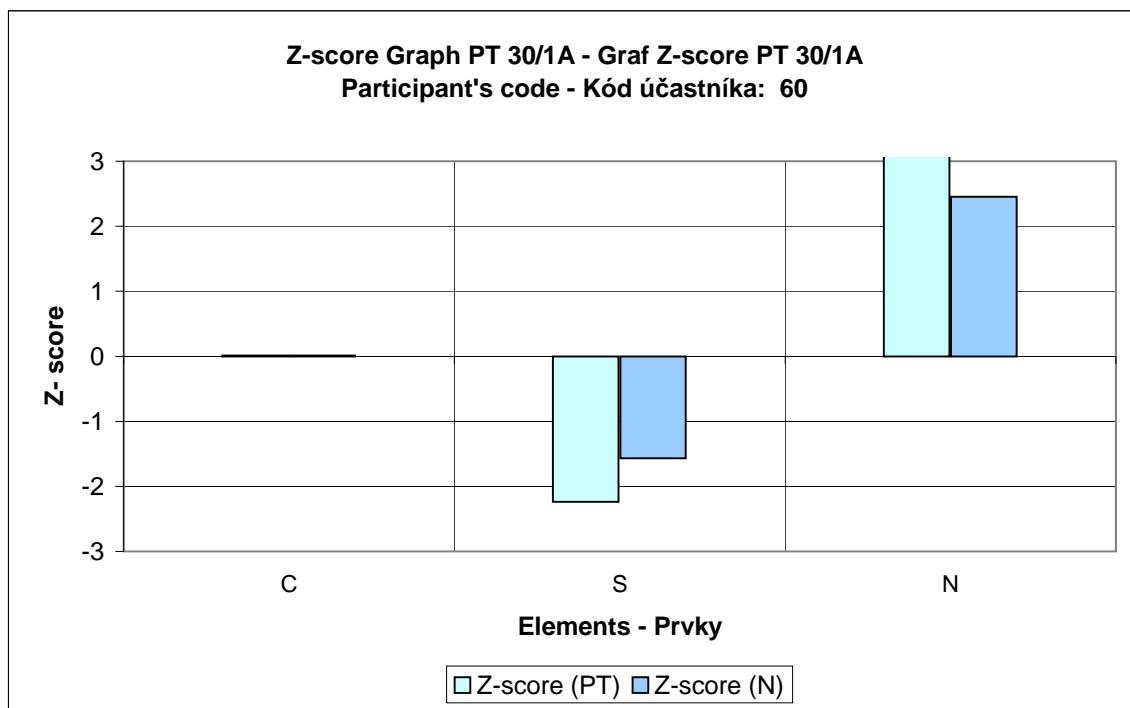

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 61 - Z-score účastníka s kódem 61**

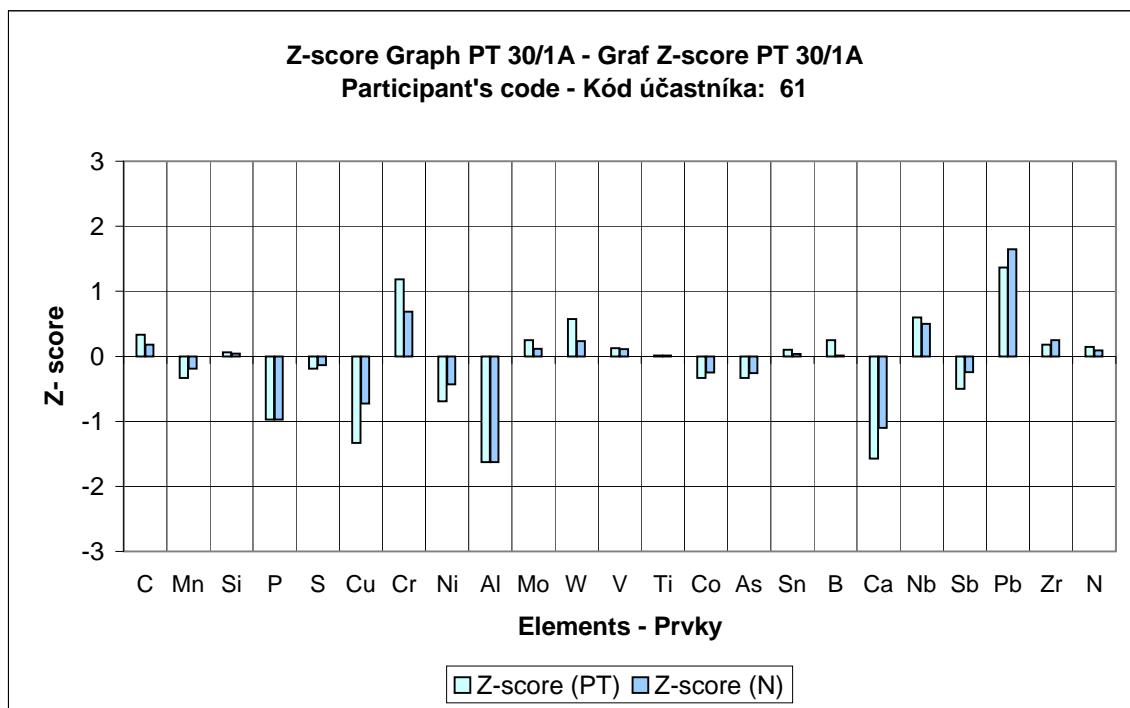

**Comments**  
**Poznámky**

$Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

$Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát


Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

**SPL**  
**1. máje 432**  
**735 31 BOHUMÍN**

**Annex 2 for Certificate of participation in PT 30/1A**

**Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 30/1A**

**Z-scores of the participant with code 62 - Z-score účastníka s kódem 62**

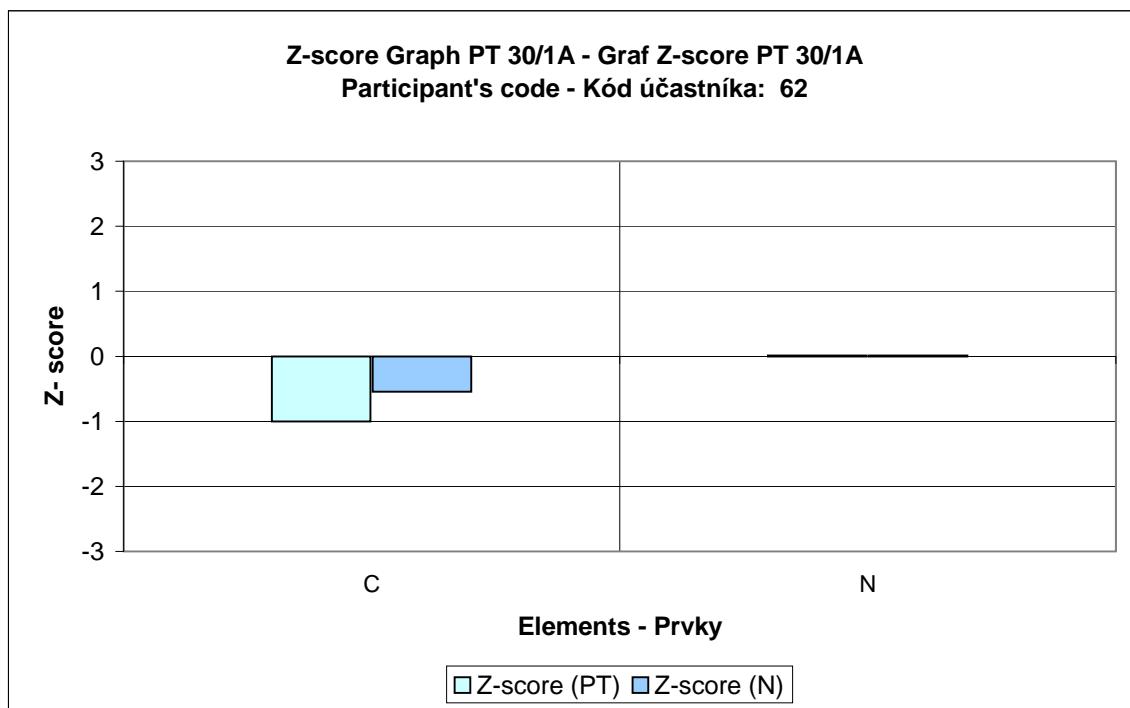

**Comments**  
**Poznámky**

- $Z_{PT}$  Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results  
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků
- $Z_N$  Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)  
on [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)  
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018)  
na [www.spl-labmat.cz](http://www.spl-labmat.cz)

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis  
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant's laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles  
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)